

Rayocomp PS 10

Biorésonateur haute performance portable

Manuel de l'utilisateur



Art.-Nr.: 9100FR

Malgré le grand nombre de remarques, de conseils et d'approches de solutions que contient le présent manuel de l'utilisateur, il ne peut pas remplacer la consultation d'un naturopathe ou médecin orienté vers les médecines naturelles. Eu outre, nous signalons que la médecine officielle n'a jusqu'à présent ni accepté, ni reconnu les rapports et liens décrits dans le présent manuel.

1.	Sommaire	2
2.	Déclaration de conformité	5
3.	Informations de base relatives à l'appareil Rayocomp PS 10	6
3.1	Contenu de la livraison	6
3.2	Caractéristiques techniques	6
3.3	Consignes de sécurité pour l'utilisation	7
3.4	Garantie	7
3.5	Nettoyage	7
3.6	Description de l'appareil	8
3.6.1	Vue avant	8
3.6.2	Vue arrière	9
3.6.3	Clavier	10
3.6.4	Ecran	11
4.	Mode d'emploi	12
4.1	Consignes d'utilisation générales	12
4.1.1	Littérature relative à la biorésonance d'après Paul Schmidt	12
4.1.2	Chargement de la batterie rechargeable intégrée	13
4.1.3	Mise en marche et arrêt de l'appareil	14
4.1.4	Sélection du menu à l'aide de la touche <i>Mode</i>	15
4.1.5	Utilisation du polarisateur intégré et du Rayotensor	19
4.1.6	Informations sur la « Green-Card » RAH	21
4.1.7	Affichage d'erreurs	22
4.2	Option de menu « Direct »	23
4.2.1	Test et harmonisation d'une valeur fondamentale de fréquence à l'aide du polarisateur intégré et du Rayotensor	23
4.2.2	Réglage des valeurs fondamentales de fréquences individuelles	24
4.2.3	Déroulement automatique d'un programme avec l'utilisation de la « Green-Card » RAH	25
4.3	Option de menu « F1 »	26
4.3.1	Informations de base concernant l'utilisation de programmes intégrés	26
4.3.2	Combinaison et harmonisation de différents programmes d'harmonisation	27
4.3.3	Charger les valeurs fondamentales de fréquences de la carte mémoire et les harmoniser	30

4.3.4	Prise en charge et harmonisation des valeurs fondamentales de fréquences issues de l'option de menu « Tester »	30
4.3.5	Utilisation des programmes d'harmonisation du système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH)	31
4.4	Option de menu « Tester »	36
4.4.1	Test de valeurs dans une plage	38
4.4.2	Test avec des valeurs de carte mémoire	39
4.4.3	Test avec des programmes intégrés	39
4.4.4	Test avec des programmes de test intégrés	40
4.4.5	Module RAH 10 : test de niveaux	41
4.4.6	Module RAH 10 : test avec des protocoles de test intégrés	45
4.4.7	Module RAH 10 : test avec la « Green-Card » RAH	46
4.4.8	Conseils importants pour le test avec le module RAH 10	47
4.5	Option de menu « Configuration »	50
4.5.1	Configuration du rétroéclairage	51
4.5.2	Suppression de valeurs et de programmes doubles	51
4.5.3	Réglage de l'avertissement sonore (bip)	52
4.5.4	Définition des valeurs de plage de test	52
4.5.5	Définition de la durée d'harmonisation des valeurs fondamentales de fréquences	53
4.5.6	Activation et désactivation de modules	54
4.5.7	Enregistrement des valeurs fondamentales de fréquences sur la carte mémoire	55
4.5.8	Afficher des informations relatives à la carte mémoire	56
4.5.9	Mise en place d'une protection de lecture pour la carte mémoire	57
4.5.10	Mise en place d'une protection d'écriture pour la carte mémoire	57
4.5.11	Suppression du contenu complet de la carte mémoire	58
4.5.12	Initialisation de la carte mémoire	58
4.5.13	Marche d'essai du moteur du module de fréquence	59
4.6	Option de menu « Info »	60
4.7	Touches de fonction spéciales	62
4.7.1	Utilisation des touches <i>IF</i>	62
4.7.2	Utilisation de la touche <i>10.0</i>	63

5.	Annexe	64
5.1	Aperçu des programmes de test intégrés	64
5.2	Aperçu des programmes Rayonex intégrés	65
5.3	Aperçu des programmes d'acuponcture intégrés	66
5.4	Aperçu des programmes spéciaux intégrés	67
5.5	Aperçu des programmes Dr. Ulrich intégrés	68
5.6	Aperçu des modules intégrables	69
5.7	Aperçu des messages d'erreur disponibles	70

Déclaration de conformité EU « Rayocomp PS 10 »

Déclaration de conformité CE

pour le produit médical de classe I désigné ci-dessous

D'article : « Rayocomp PS 10 »

N° d'article : 2000

Nous confirmons par la présente que ce produit satisfait aux exigences fondamentales (Annexe I) de la directive concernant les produits médicaux (93/41/CEE) inclusive directive CE 2007/47/EG changée dans son état à la livraison.
Les normes harmonisées correspondantes ont été respectées et appliquées.

La présente déclaration est remise sous notre responsabilité pour le fabricant :


RAYONEX Schwingungstechnik GmbH
Sauerland-Pyramiden 1
D-57368 Lennestadt

par:

Dipl. Ing. Dietmar Heimes
Gérant / SiB MP

Lennestadt,
(lieu)

07.04.2010
(date)


.....
(signature)

3. Informations de base relatives à l'appareil Rayocomp PS 10

3.1 Contenu de la livraison

La livraison comprend:	1. l'appareil Rayocomp PS 10
	2. un polarisateur intégré
	3. une batterie intégrée
	4. un chargeur de batterie
	5. un manuel de l'utilisateur
	6. une mallette de transport
	7. le carton d'emballage

Préservez impérativement l'emballage afin de pouvoir renvoyer l'appareil dans sa mallette de transport et son carton d'emballage d'origine dans le cas où il devait faire l'objet d'une maintenance (par ex. à des fins de réparation). Dans le cas contraire, la garantie serait annulée.

En cas de perte de l'ancien emballage, un nouvel emballage pourra vous être envoyé contre paiement.

Lors du renvoi de l'appareil, veillez à ce que les accessoires soient bien immobilisés dans la mallette! Veuillez joindre la batterie correspondante lors du renvoi du PS 10.

3.2 Caractéristiques techniques

Poids de l'appareil Rayocomp PS 10 :	1,6 kg
Poids total avec mallette et accessoires :	9,7 Kg
Hauteur :	100 mm
Largeur :	160 mm
Profondeur :	260 mm
Alimentation électrique du chargeur :	100 - 240 V / 50 - 60
Hz	primaire, 17 V / 0,8 A
courant	continu secondaire
Puiss. max. absorbée lors du chargement :	24 W
Durée de service avec batterie entièrement chargée :	minimum 8 heures
Plage de température :	15° C - 35° C

L'appareil ne doit pas être soumis à de trop importantes variations de température, puisque alors la formation de condensation ne peut pas être totalement exclue.

Si l'appareil devait se refroidir fortement (par ex. durant un transport - températures inférieures à 5° C), vous devez attendre que sa température corresponde à nouveau à la plage de température de service indiquée ci-dessus avant de le mettre en marche.

3.3 Consignes de sécurité pour l'utilisation

L'appareil Rayocomp PS 10 est chargé avec une tension continue. Le courant de charge est de 800 mA. Attention : l'appareil Rayocomp PS 10 ne doit être utilisé qu'avec le chargeur de batterie fourni par Rayonex.

- Vous devez donc vous assurer que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans l'appareil (risque de court-circuit).
- Assurez-vous également que les enfants ne puissent pas introduire des objets métalliques pointus dans l'appareil (risque d'électrocution).
- Assurez-vous que les câbles de connexion fournis avec les détecteurs ne soient utilisés que pour relier les détecteurs à l'appareil.
- N'utilisez l'appareil Rayocomp PS 10 qu'en mode batterie et sans que le câble de chargement de batterie ne soit branché.

Lors de l'utilisation des détecteurs (notamment le détecteur pointeur utilisé pour l'acuponcture), vous devez veiller à ce que la manipulation de l'appareil soit faite avec les précautions nécessaires (risque de blessure des yeux, ...).

3.4 Garantie

La durée de garantie est de 1 an à compter de la date de livraison et la garantie ne s'applique que si l'appareil n'a pas été ouvert et que le sceau de garantie n'est pas détérioré. La garantie s'annule en cas d'utilisation non conforme. Si une maintenance était nécessaire durant la période de garantie, celle-ci sera facturée comme il est d'usage pour les révisions.

3.5 Nettoyage


La surface de l'appareil doit être nettoyée une fois par semaine avec un chiffon doux et un peu d'alcool. N'utilisez jamais des produits de nettoyage agressifs.

Les détecteurs qui sont en contact avec le patient (par ex. les détecteurs pour mains ou pour pieds) doivent être nettoyés après chaque utilisation, de préférence à l'alcool.

3.6 Description de l'appareil

La suite du présent mode d'emploi contient de nombreuses références à des touches ou des éléments de l'appareil Rayocomp PS 10. Afin de vous en faciliter l'affectation, vous trouverez ci-dessous des illustrations avec des brèves descriptions.

3.6.1 Vue avant

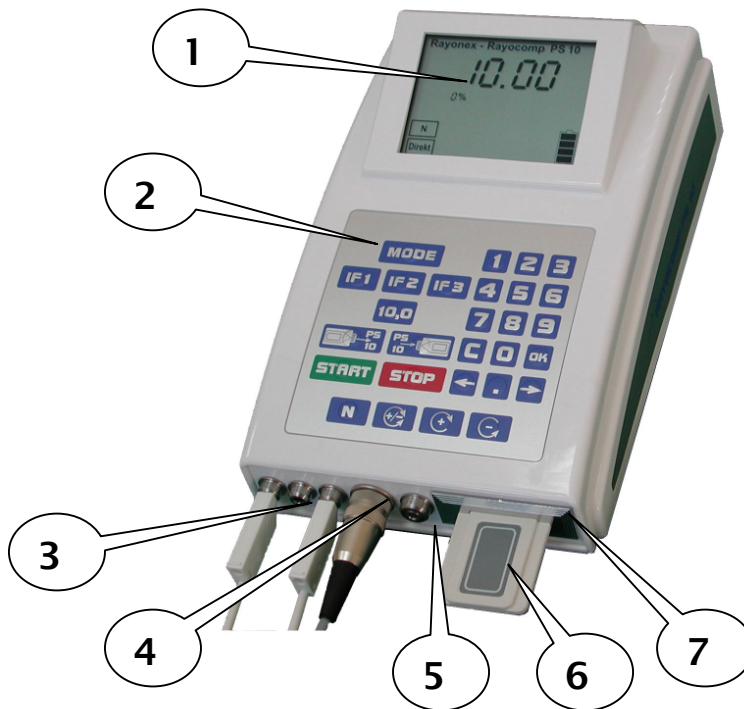


Vue avant de l'appareil Rayocomp PS 10

Légende:

- 1: Ecran
- 2: Clavier
- 3: Trois connecteurs de sortie pour la connexion des détecteurs de main, de pied ou des détecteurs bracelets, ainsi que les gobelets mesureurs et protégés.
- 4: Connecteur pour le Rayotensor. Pour assurer une bonne connexion, le connecteur du Rayotensor est branché et ensuite bloqué à l'aide de la vis moletée.
- 5: Connecteur d'entrée.
- 6: Carte mémoire
- 7: Entrée de carte mémoire

3.6.2 Vue arrière

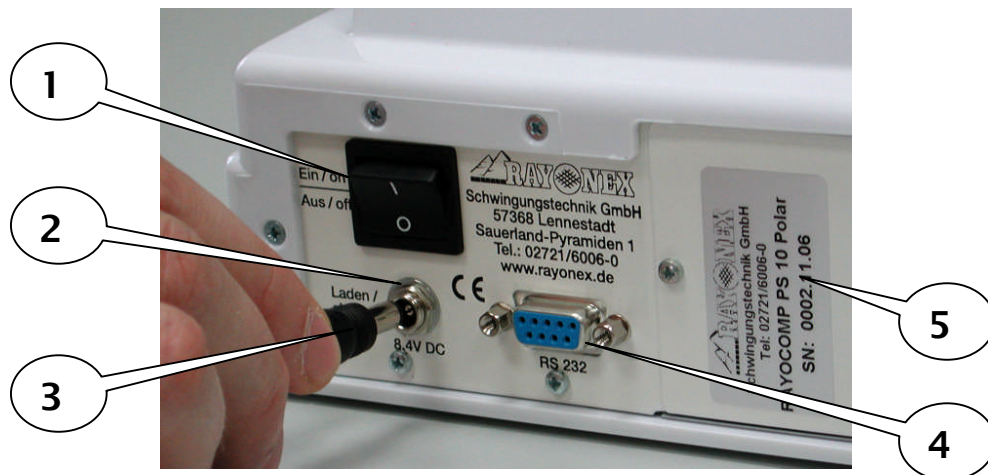


Vue arrière de l'appareil Rayocomp PS 10

Légende:


- 1: Interrupteur marche/arrêt
- 2: Douille de chargement de batterie
- 3: Connecteur à insérer dans la douille de chargement pour procéder au chargement de la batterie
- 4: Interface pour la mise à jour des programmes
- 5: Autocollant avec des informations concernant le n° de série, l'année de construction, etc.

3.6.3 Clavier

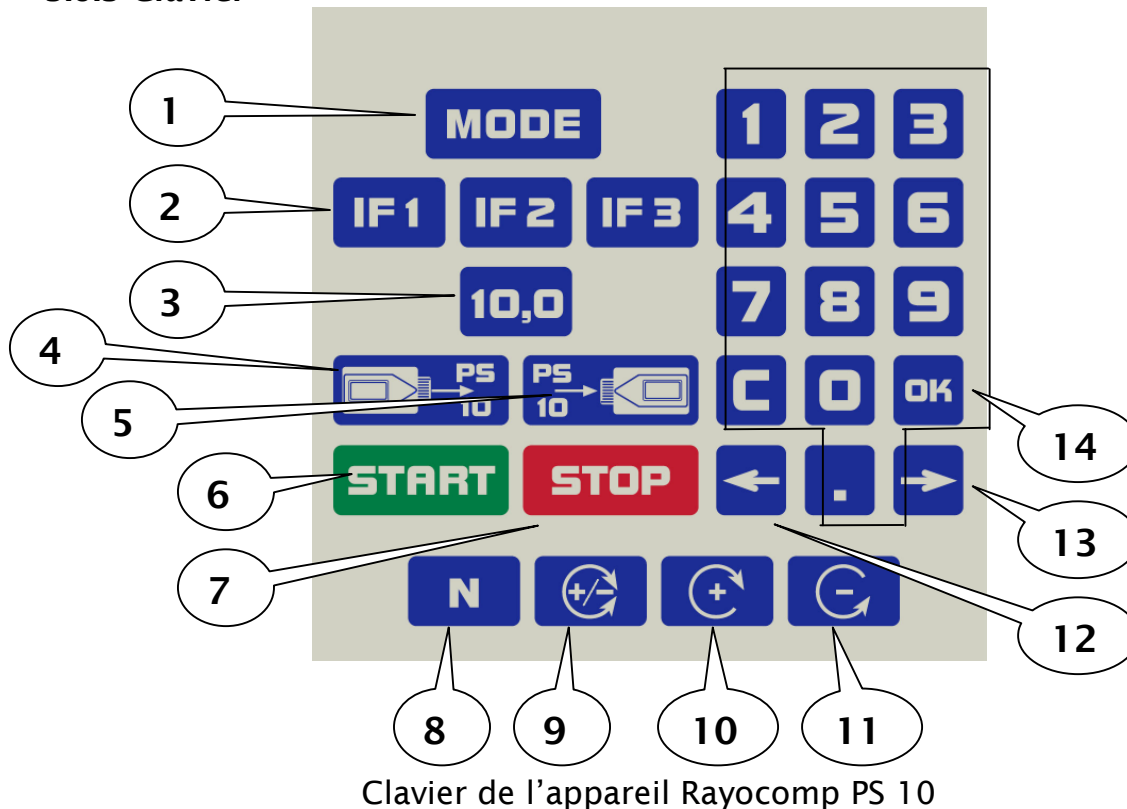**Légende:**

- 1: Touche Mode pour la sélection de l'option de menu
- 2: Touches IF1 - IF3 pour définir les valeurs fondamentales de fréquences souvent utilisées
- 3: Touche 10.0 pour l'accès rapide à cette valeur importante ainsi que pour l'activation des protocoles de test du module M10
- 4: Touche pour le chargement des valeurs dans l'appareil à partir d'une carte mémoire
- 5: Touche pour sauvegarder les valeurs de l'appareil sur la carte mémoire
- 6: Touche de démarrage, par ex. pour le démarrage des programmes F1
- 7: Touche d'arrêt, pour interrompre un déroulement automatique, par ex. annuler une fonction
- 8: Touche N du polarisateur, pour commuter le polarisateur sur neutre
- 9: Touche +/- du polarisateur, pour activer la fonction bipolaire
- 10: Touche + du polarisateur, pour activer une polarisation à rotation droite
- 11: Touche - du polarisateur, pour activer une polarisation à rotation gauche
- 12: Flèche de gauche, par ex. pour la sélection de la valeur précédente lors du déroulement automatique du programme
- 13: Flèche de droite, par ex. pour la sélection de la valeur suivante lors du déroulement automatique du programme
- 14: Clavier numérique pour la saisie de chiffres, de numéros, de valeurs fondamentales de fréquences ; la touche C permet d'annuler ; le point permet d'indiquer par ex. une valeur précise (5.75).

3.6.4 Ecran

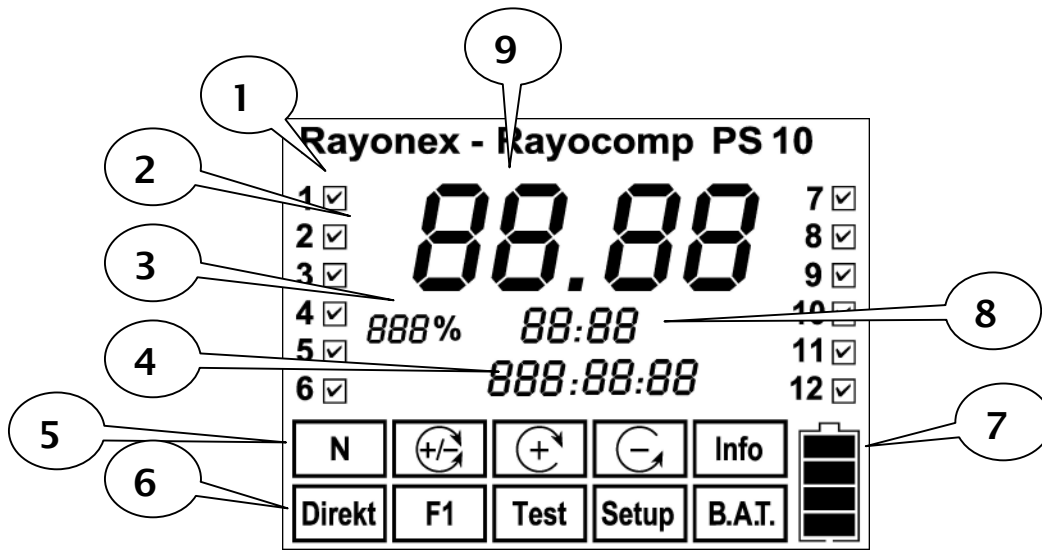

Ecran de l'appareil Rayocomp PS 10

Légende:

- 1/2: Numérotation des modules. L'appareil Rayocomp PS 10 est prévu pour l'intégration d'un maximum de 12 modules différents. En sélectionnant l'option de menu « Info », les modules déjà intégrés dans l'appareil s'affichent.
- 3: Cette zone indique l'état de maintenance actuel de l'appareil. Après environ 6.000 heures de service, l'appareil affichera 100 % (maintenance nécessaire).
- 4: Lors d'une harmonisation, cette zone affiche la durée d'harmonisation totale non encore effectuée.
- 5: Cette zone affiche la polarisation configurée actuellement pour l'appareil.
- 6: Cette zone affiche l'option de menu sélectionnée actuellement.
- 7: Ce symbole indique le niveau de charge de la batterie. Si les 4 barres sont visibles, la batterie est pleine ; si aucune barre ne s'affiche, la batterie est vide.
- 8: Lors d'une harmonisation avec les programmes de biorésonance d'après Paul Schmidt (BnPS), cette zone affiche la durée d'harmonisation non encore effectuée de la valeur fondamentale de fréquence actuelle.
- 9: Cette zone affiche la valeur fondamentale de fréquence configurée actuellement. La taille des chiffres est particulièrement grande afin de permettre une bonne lisibilité.

4. Mode d'emploi

4.1 Consignes d'utilisation générales

4.1.1 Littérature relative à la biorésonance d'après Paul Schmidt

Ce n'est pas l'objet d'un mode d'emploi de décrire toutes les facettes et possibilités d'un procédé, notamment lorsqu'il s'agit d'un domaine aussi complexe que la biorésonance d'après Paul Schmidt.

Il existe maintenant suffisamment de littérature à ce sujet pour que vous puissiez vous informer des applications possibles du procédé. Nous recommandons par exemple le livre « Biorésonance d'après Paul Schmidt », ouvrage de 424 pages.

Le livre « Biorésonance d'après Paul Schmidt » peut être obtenu sans difficultés auprès de son éditeur, dont voici l'adresse :

Spurbuchverlag
Am Eichenhügel 4

96148 Baunach, Allemagne

Tél. : +49 95 44 15 61

Internet : www.spurbuch.de
E-mail : info@spurbuch.de



4.1.2 Chargement de la batterie rechargeable intégrée

L'appareil Rayocomp PS 10 est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, permettant de l'utiliser sans qu'il soit connecté au réseau électrique.

Par principe, l'appareil Rayocomp PS 10 ne doit pas être utilisé durant le processus de chargement de la batterie.

L'appareil Rayocomp PS 10 se recharge le mieux lorsqu'il est éteint. La durée de chargement d'une batterie vide est d'env. 4 heures.

Pour éviter les perturbations électromagnétiques inutiles, débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas.

Pour charger l'appareil Rayocomp PS 10, procédez comme suit:

1. Arrêtez l'appareil.
2. Branchez le chargeur de batterie sur une prise électrique.
3. Enfichez le câble de chargement à l'arrière de l'appareil (se reporter au chapitre 3.6.2.).
4. Le chargeur indique les différents processus de chargement (se reporter au tableau). Lorsque la DEL verte s'allume en continu, le processus de chargement est terminé.
5. Débranchez le câble à l'arrière de l'appareil et le chargeur de la prise électrique.



Fonction		Jaune	Vert
Opérationnel :	Le chargeur est en attente de processus de chargement	allumée	
Précharge :	Contrôle de la nécessité de chargement	clignote lentement	
Charge principale :	La batterie est chargée avec un courant constant		clignote rapidement
Charge finale :	Le courant de chargement est diminué		clignote lentement
Erreur :	Le chargement ne peut pas être débuté	clignote rapidement	
Terminé :	Rayocomp PS 10 peut être utilisé		allumée
Attendre :	Le chargeur n'est pas prêt	clignote lentement	clignote lentement


Remarque: L'état de chargement de la batterie est toujours affiché lorsque l'appareil fonctionne. Cet affichage par barres vous permet d'évaluer combien de temps vous pouvez encore utiliser l'appareil avant de devoir recharger la batterie.

4.1.3 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Utilisez l'interrupteur disposé à l'arrière de l'appareil Rayocomp PS 10 pour le mettre en marche et l'arrêter. Veillez à ce qu'aucune carte mémoire ne soit enfichée dans l'appareil lorsque vous le mettez en marche. Si l'appareil Rayocomp PS 10 devait rester sans surveillance pendant une durée prolongée (par ex. durant la nuit), vous devez vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. **Un seul déchargement complet suffit à endommager définitivement la batterie.**



Après la mise en marche de l'appareil, celui-ci réalise un test bref. Outre le test mécanique, la batterie est également contrôlée. Si le message « Er 29 » s'affiche alors, la batterie doit être chargée avant que l'appareil ne soit mis en service. Ensuite, l'appareil passe à l'option de menu « Direct » et est immédiatement opérationnel. Les éléments suivants s'affichent à l'écran:

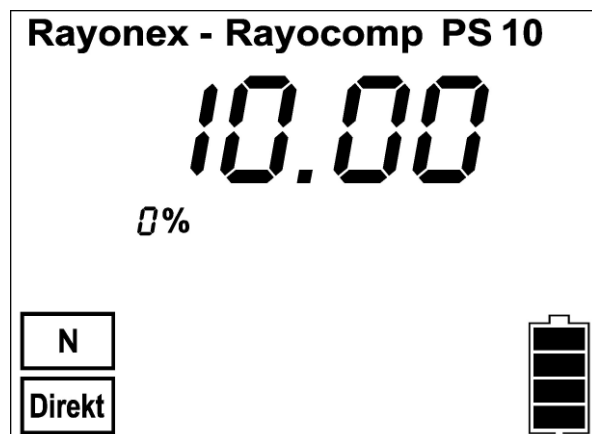

Il n'est pas nécessaire d'afficher une option de menu spécifique pour arrêter l'appareil. Vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment. N'oubliez pas cependant que lorsque vous arrêtez l'appareil, les valeurs de résonance déterminées avec l'option de menu « Tester » ainsi que les programmes RAH trouvés sont perdus. Si la batterie atteint en cours d'utilisation un niveau si faible que le fonctionnement conforme de l'appareil n'est plus assuré, ceci est signalé par une alarme sonore répétitive. **Dans ce cas, la batterie doit être chargée immédiatement afin d'éviter tout endommagement.**

Remarque importante:


Vous ne pouvez pas endommager l'appareil en l'arrêtant à un moment quelconque. Les programmes d'harmonisation intégrés ne seront pas perdus, ni le matériel endommagé.

4.1.4 Sélection du menu à l'aide de la touche *Mode*

L'appareil Rayocomp PS 10 dispose de plusieurs options de menu. Chaque option de menu offre des possibilités d'application spécifiques. La répartition en options de menu sert donc à faciliter l'utilisation de l'appareil. Les options de menu suivantes sont disponibles:

1. « Direct »: Utilisez cette option de menu pour éditer rapidement des valeurs fondamentales de fréquences individuelles. Cette option de menu comprend presque toutes les fonctions des anciens Rayomètres.
2. « F1 »: L'option de menu « F1 » contient deux programmes bien distincts. D'une part, le programme de biorésonance d'après Paul Schmidt qui est affiché sur l'écran par « bnPS ». Après peu de temps, l'affichage « P_._ » apparaît sur l'écran. Avec les programmes BnPS, vous pouvez lancer les programmes d'harmonisation intégrés dans l'appareil ou préalablement enregistrés sur des cartes mémoire. Ces programmes se déroulent automatiquement si les modules correspondants ont été activés dans l'appareil. Le programme RAH, contenu également dans l'option de menu « F1 », est affiché uniquement s'il est activé dans l'appareil. Dans ce cas, l'affichage « rAH » apparaît sur l'écran. Peu de temps après, la demande de saisie de programme RAH « _ _ _ _ » s'affiche. Par la suite, l'option RAH du menu sera affichée par « F1 – rAH », parallèlement, lors d'une harmonisation avec les valeurs fondamentales de fréquences, « F1 – bnPS » s'affiche.
3. « Tester »: Cette option de menu offre toutes les fonctions nécessaires pour tester des valeurs fondamentales de fréquences. Si le module M10 est activé, les programmes RAH peuvent également être testés. Son affichage est identique à celle du menu « F1 ». Le mode d'emploi distingue entre « Test-BnPS » et « Test-RAH ».
4. Configuration (« Setup »): Cette option de menu permet de modifier les préreglages de l'appareil, de lire des informations relatives aux cartes mémoire, d'activer ou de désactiver des modules et d'effectuer un test de l'appareil.
5. « Info »: Sélectionnez cette option de menu pour obtenir des informations concernant le numéro de série de l'appareil. La version de logiciel intégrée ainsi que le type de matériel seront également indiqués. Particulièrement important : vous pouvez voir immédiatement quels sont les modules intégrés dans l'appareil Rayocomp PS 10.



Après avoir été mis en marche, l'appareil Rayocomp PS 10 affiche sur l'écran l'option de menu « Direct » :

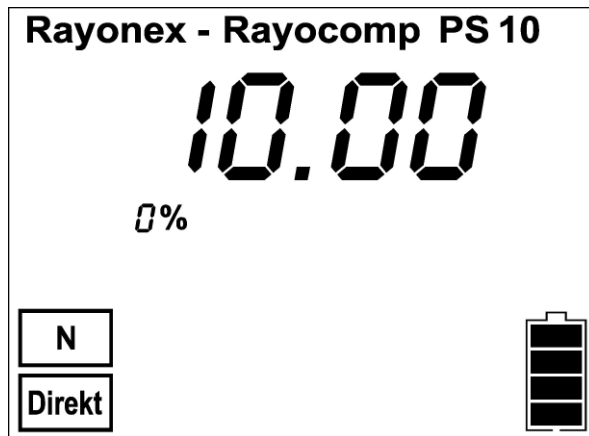

Appuyez maintenant sur la touche

MODE

L'appareil Rayocomp PS 10 passe à l'option de menu « F1-BnPS » et affiche les éléments suivants à l'écran :

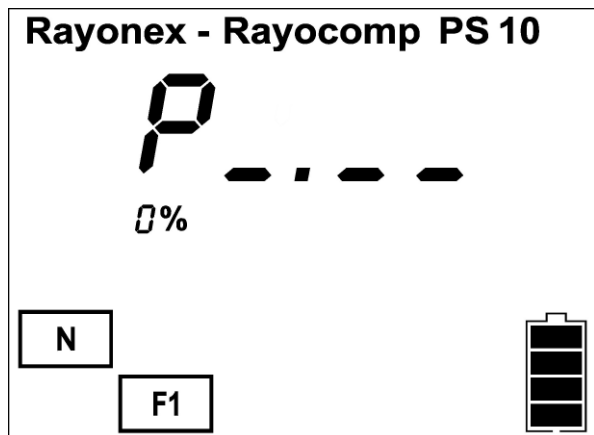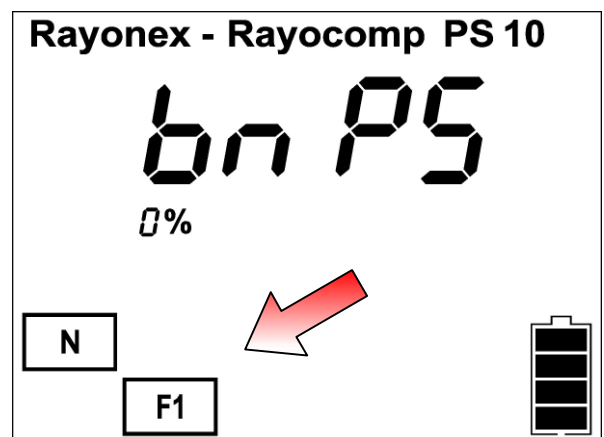



Si la touche « Mode » n'est pas activé une deuxième fois, l'appareil Rayocomp PS 10 passe automatiquement à l'affichage de saisie afin de pouvoir saisir les programmes BnPS.

Appuyez à nouveau sur la touche

MODE

L'appareil PS 10 passe maintenant au module RAH, sous condition que ce module soit activé. Dans le cas où le module 8, le module 9 ou le module 10 est activé, l'écran affiche brièvement « rAH ». Ensuite, les programmes RAH peuvent être saisis en utilisant l'affichage de saisie « _ _ _ _ ».

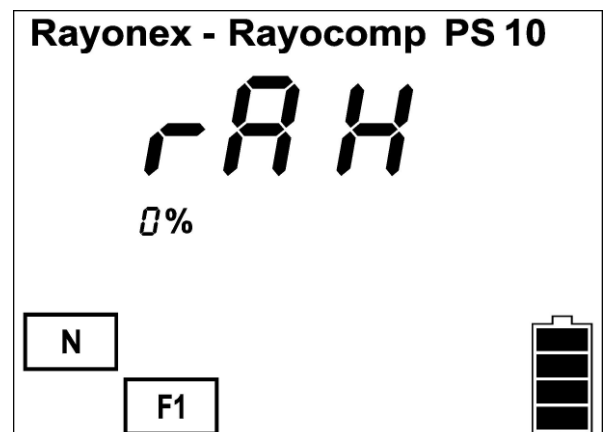


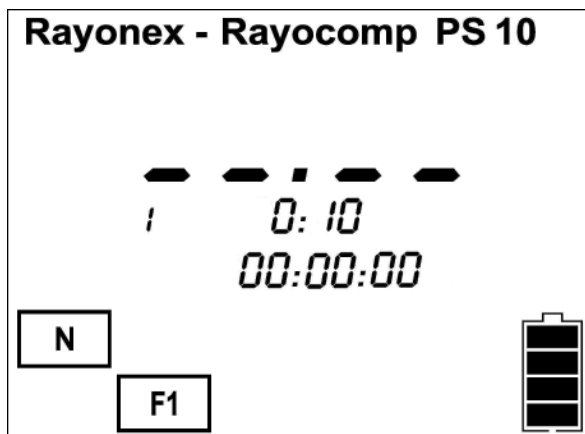

Appuyez à nouveau sur la touche


MODE

L'appareil Rayocomp PS 10 passe à l'option de menu « Configuration » et affiche les éléments suivants à l'écran:

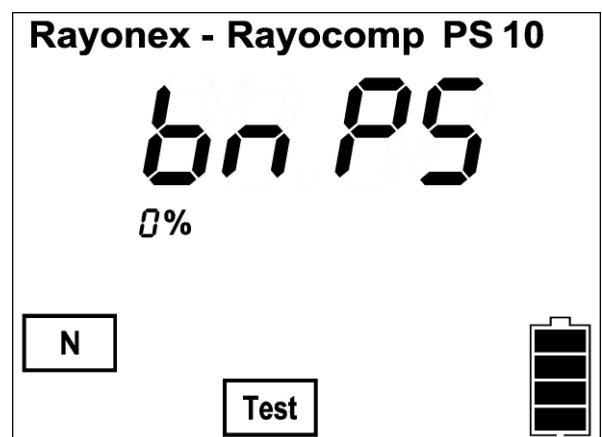

Si le module 10 est activé, l'appareil affiche d'abord l'option de menu « Test-bnPS », puis l'option « Test-rAH ».

Si la touche « Mode » n'est pas activé encore une fois après l'affichage de l'option « Test-bnPS », l'appareil affiche la demande de saisie suivante:

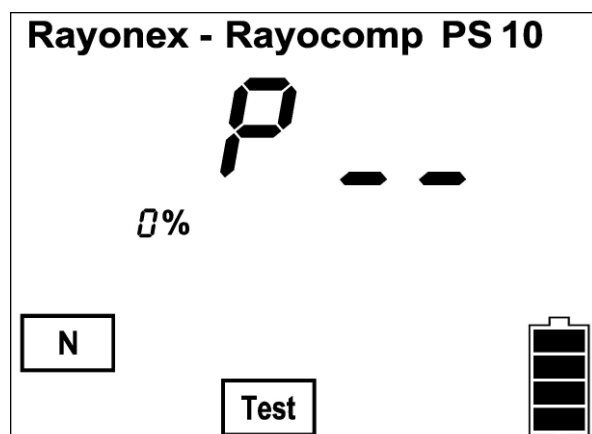


Vous pouvez maintenant tester les valeurs fondamentales de fréquences. Se reporter au chapitre 4.4 pour plus d'informations.

Appuyez à nouveau sur la touche

MODE


L'appareil Rayocomp PS 10 passe à l'option de menu « Configuration » et affiche les éléments suivants à l'écran:

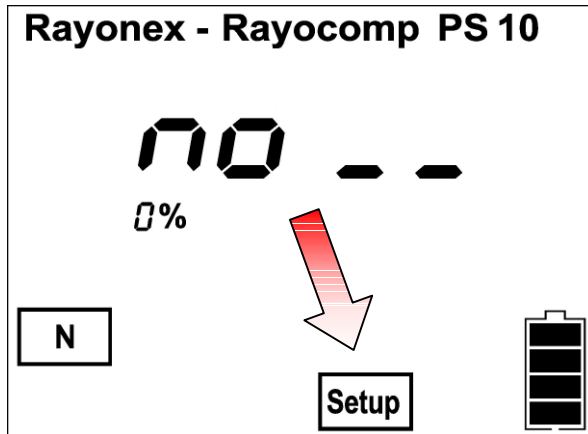

Appuyez à nouveau sur la touche


MODE

L'appareil Rayocomp PS 10 passe à l'option de menu « Info » et affiche les éléments suivants à l'écran:

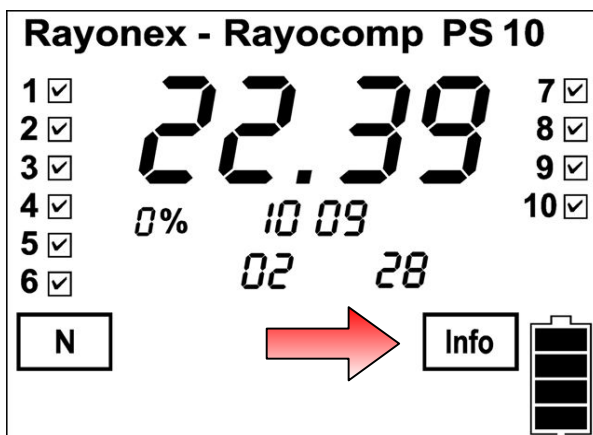

MODE

Si vous appuyez encore une fois sur la touche **MODE**, vous revenez à l'option de menu « Direct », et les éléments suivants sont à nouveau affichés à l'écran:

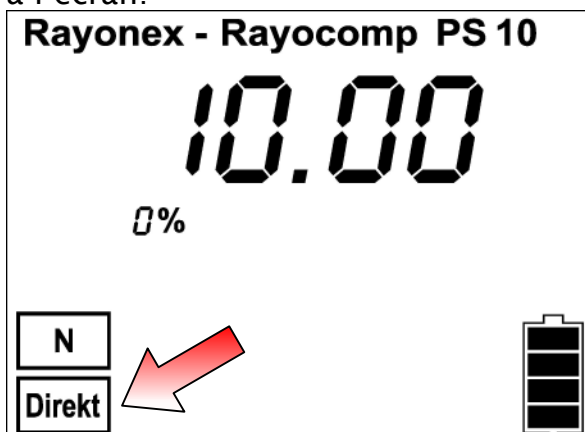

4.1.5 Utilisation du polarisateur intégré et du Rayotensor


Comme dans l'appareil Rayocomp PS 1000 polar, le polarisateur a également été intégré dans l'appareil Rayocomp PS 10, ce qui augmente encore davantage le confort d'utilisation.

Les fonctions du polarisateur intégré peuvent être utilisées d'une part à l'aide du clavier, et d'autre part via le Rayotensor. Comme il est plutôt gênant de devoir appuyer sur le clavier en cours de test, nous vous conseillons d'exécuter dès le départ les fonctions du polarisateur intégré à l'aide du bouton situé sur le Rayotensor.


Par principe, l'utilisation du polarisateur avec l'appareil Rayocomp PS 10 comporte les avantages suivants:

- Lors du test, il est possible de déterminer à l'aide du polarisateur si une perturbation est forte ou faible, et quelle est la polarisation optimale.
- Notamment lors de l'harmonisation, la fonction bipolaire (+/-) agit de façon intensifiante.

Les fonctions du polarisateur sont commandées à l'aide de ces quatre touches du clavier:

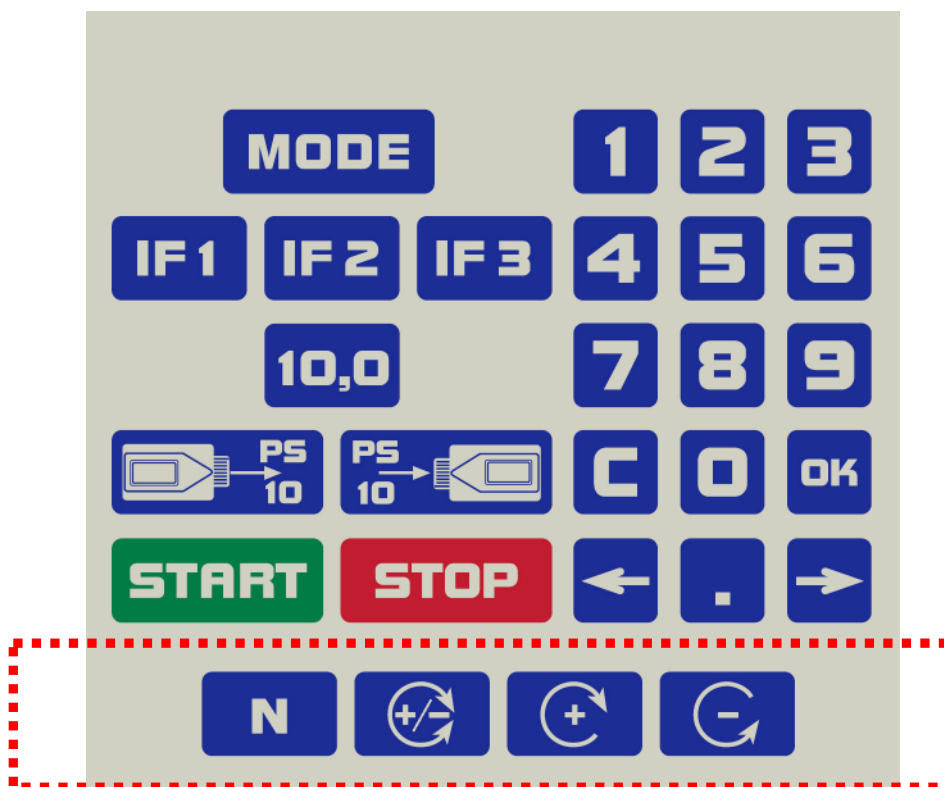


Durant le test, les fonctions du polarisateur peuvent également être réglées directement sur le Rayotensor. En déplaçant le bouton du Rayotensor en direction du câble de connexion, donc vers l'arrière, on modifie la polarisation actuelle des fréquences. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les fonctions du Rayotensor (vert):

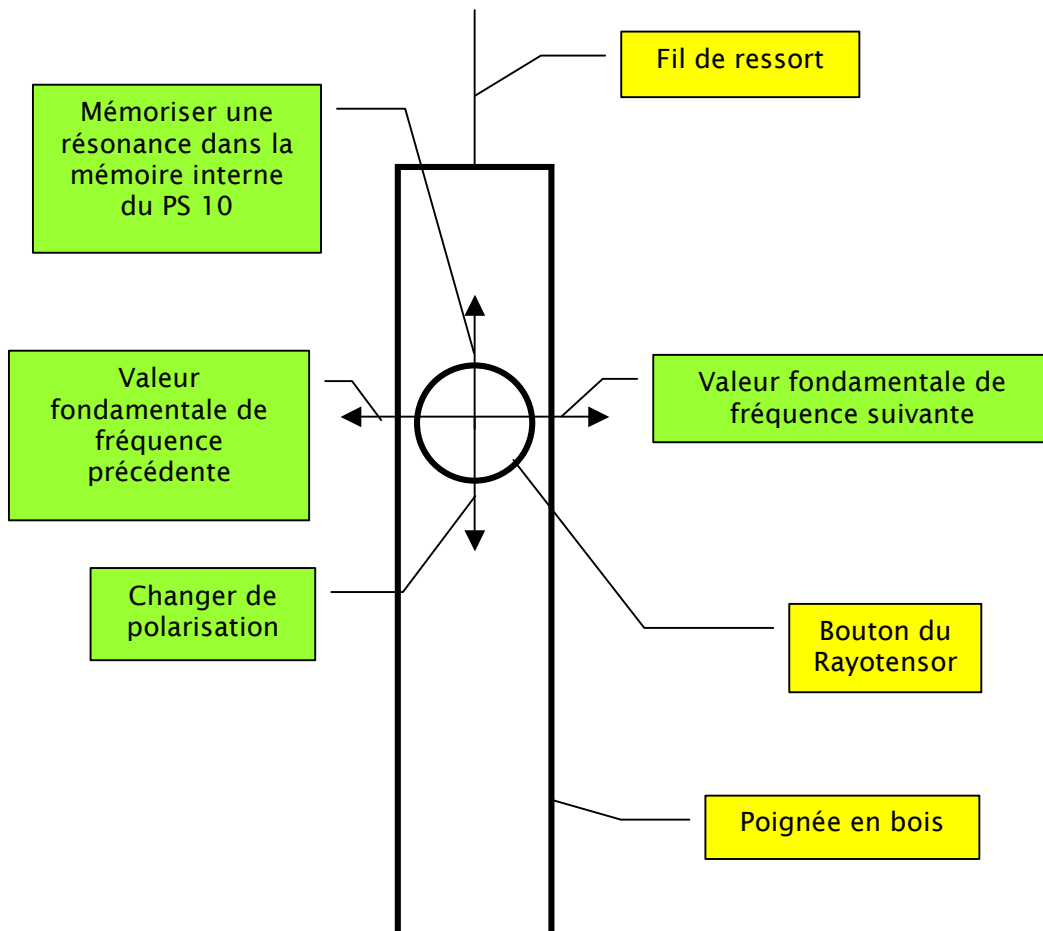

Utilisation du Rayotensor lors du test de valeurs fondamentales de fréquences. Cette fonction s'applique dans l'option de menu « Test-BnPS ».

Les déroulements précis d'un test et d'une harmonisation figurent dans le chapitre 4.2.1.

La polarisation effectivement paramétrée s'affiche à l'écran:

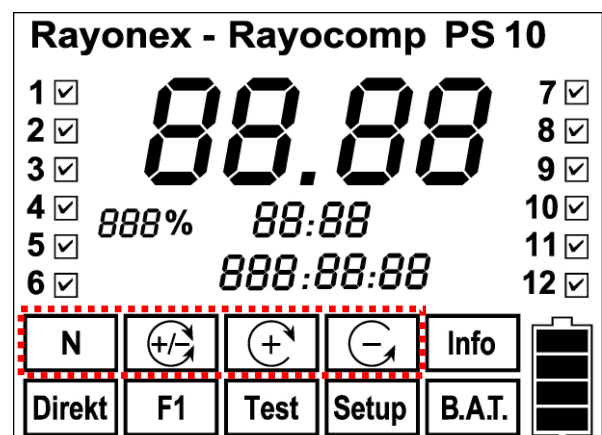

4.1.6 Informations sur la « Green-Card » RAH

L'idée sous-jacente à la nouvelle « Green-Card » RAH est simple et géniale à la fois. Quand l'utilisateur d'un Rayocomp PS 1000 polar ou d'un Rayocomp PS 10 déterminait à l'aide du RAH les programmes à inclure dans l'harmonisation, il devait les noter ou les imprimer pour une utilisation ultérieure. Il est désormais possible d'enregistrer ces combinaisons de programmes sur une carte mémoire spéciale, la nouvelle « Green-Card » RAH. Il est par exemple possible d'enregistrer les programmes testés sur le Rayocomp PS 1000 polar sur une « Green-Card » RAH et de les transmettre au patient pour son traitement à domicile avec le Rayocomp PS 10. Grâce à la « Green-Card » RAH, les deux appareils travaillent pour ainsi dire main dans la main.

Du fait que les programmes RAH sont souvent harmonisés avec des durées différentes, il est possible d'enregistrer sur une « Green-Card » RAH les programmes RAH et leurs durées d'harmonisation individuelles. La « Green-Card » RAH est également utilisable de façon optimale en association avec les nouvelles possibilités de test du module M10. Prenons un exemple : vous voulez appeler et tester tous les programmes RAH correspondants à l'affection Hypertonie. Les programmes RAH requis pour l'harmonisation peuvent être analysés avec les deux appareils et enregistrés après le contrôle sur la nouvelle « Green-Card » RAH. Tant le PS 1000 polar que le PS 10 ajoutent automatiquement lors de l'enregistrement les durées d'harmonisation prévues. Il est également possible de lire les valeurs enregistrées sur la « Green-Card » RAH pour un contrôle ultérieur. Cela fait gagner du temps et évite les erreurs de saisie.

Il est possible d'enregistrer sur une « Green-Card » RAH jusqu'à 200 programmes RAH et leurs durées d'harmonisation individuelles. Il est bien sûr possible d'effacer le contenu de la « Green-Card » RAH, d'effectuer un nouvel enregistrement, ou de la protéger contre l'écriture.

Ce n'est pas tout ! Car une « Green-Card » RAH associe idéalement la biorésonance d'après Paul Schmidt et le RAH. En parallèle à l'utilisation des programmes RAH, des fréquences individuelles de biorésonance d'après Paul Schmidt (issues par ex. d'un test individuel des valeurs de plage) sont souvent utilisées ; les ingénieurs de Rayonex ont donc trouvé le moyen d'enregistrer sur la « Green-Card » RAH des fréquences individuelles (jusqu'à 500 valeurs différentes) et des programmes RAH. Une fonction spéciale a été ajoutée sous la rubrique du menu principal de Rayocomp PS 1000 polar et sous le menu principal de Rayocomp PS 10. Lors de l'insertion d'une « Green-Card » RAH, un processus automatique d'harmonisation démarre. D'abord les fréquences individuelles enregistrées sur la « Green-Card » RAH sont harmonisées selon la durée prédéfinies dans le menu « Configuration », puis les programmes RAH enregistrés sur la même carte sont harmonisés selon leur durée d'harmonisation individuelle.

Les patients peuvent ainsi utiliser très facilement à leur domicile une « Green-Card » RAH préparée par le thérapeute. Dès l'insertion de la « Green-Card » RAH dans le menu « Direct », le démarrage du processus d'harmonisation est entièrement automatique.


4.1.7 Affichage d'erreurs

Même si l'utilisation de l'appareil Rayocomp PS 10 est particulièrement facile, il peut arriver que vous appuyiez à un moment donné au cours du programme sur une touche à laquelle n'est affectée aucune fonction. Vous en êtes alors informé par un signal sonore.

L'appareil Rayocomp PS 10 différencie trois types d'erreurs et dispose d'autant de signaux sonores:

1. **Un son prolongé:** l'appareil confirme ainsi une action achevée avec succès, par ex. une saisie ou un enregistrement.
2. **Deux sons courts:** la touche actionnée ne dispose à cet endroit d'aucune fonction spécifique.
3. **Deux sons prolongés:** une erreur critique est survenue. L'appareil édite un code d'erreur. Vous trouverez en annexe (chapitre 5.7) la liste des messages et des défaillances correspondantes.

Lorsqu'il constate une erreur, l'appareil affiche par ex. les éléments suivants:

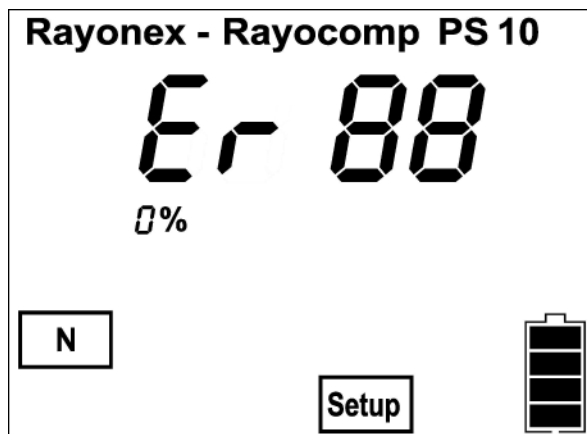

En consultant la liste figurant dans le chapitre 5.7, vous constaterez que le message d'erreur « Er 88 » (« Er » est une abréviation pour « Erreur ») signale, que vous avez tenté de lire les informations d'une carte mémoire, alors que celle-ci n'est pas insérée.

Remarque : le signal sonore peut être activé ou désactivé dans l'option de menu « Configuration » (se reporter au chapitre 4.5.3).

4.2 Option de menu « Direct »

4.2.1 Test et harmonisation d'une valeur fondamentale de fréquence à l'aide du polarisateur intégré et du Rayotensor

Indépendamment du fait que vous souhaitiez tester une valeur fondamentale de fréquence, un allergène, un parasite, un Chakra ou autre, le déroulement du test et de l'harmonisation est toujours identique.

En guise d'exemple, nous expliquerons ci-dessous le test du foie (valeur fondamentale de fréquence 56.00).

Avant de débiter le processus de test proprement dit, vous devez prendre des mesures différentes si vous effectuez le test sur vous-même ou sur une autre personne. Si vous vous testez vous-même, connectez-vous à l'aide des détecteurs de main et de pied ou des détecteurs bracelets. Comme lors du test vous tenez le Rayotensor dans la main droite, touchez avec votre index la vis moletée du Rayotensor. Ainsi les spectres de fréquence de l'appareil accéderont également au circuit du bras droit. Si vous testez une autre personne, connectez-la à l'aide des détecteurs de main et de pied ou des détecteurs bracelets. Dans ce cas, vous ne devez **pas** toucher la vis moletée avec votre index, afin d'éviter de tester par mégarde vos propres résonances.

Régalez alors dans l'appareil Rayocomp PS 10 la valeur fondamentale de fréquence 56.00 (exemple) sous l'option de menu « Direct ». Régalez le polarisateur intégré dans l'appareil sur N. Testez maintenant à l'aide du Rayotensor si le mouvement constaté est rotatif (rotation à gauche ou à droite) ou linéaire. En cas de rotation, le champ dans l'organisme qui est relié à la valeur fondamentale de fréquence est stable et n'a donc pas besoin de traitement. Si le mouvement constaté est linéaire, vous êtes impérativement face à un blocage énergétique.


Si vous souhaitez déterminer avec plus de précision quelle est la polarisation qui aidera au mieux l'organisme, ou si la perturbation est forte ou faible, appuyez, une fois que vous avez testé le mouvement linéaire sur N, le bouton du Rayotensor vers le bas. Le polarisateur passe alors à la position +/- . Si le Rayotensor enregistre maintenant une rotation, la perturbation n'est pas très importante. Si le mouvement linéaire persiste sur la polarisation +/- , la perturbation est plus importante. Poussez alors le bouton vers le bas et testez si la polarisation + réglée fournit une rotation. Si oui, la polarisation + est celle qui est la mieux adaptée à l'harmonisation. Si cependant vous ne constatez toujours pas de rotation, repoussez le bouton du Rayotensor à nouveau vers le bas. Vous verrez alors que la rotation est constatée sur la polarisation - .

L'harmonisation est achevée dès que le Rayotensor affiche une rotation lorsque la polarisation est réglée sur N.

4.2.2 Réglage des valeurs fondamentales de fréquences individuelles

L'option de menu « Direct » offre dans l'appareil Rayocomp PS 10 presque la totalité des fonctions des Rayomètres antérieurs. En outre, avec le nouvel appareil Rayocomp PS 10, il n'est plus nécessaire de régler manuellement la valeur fondamentale de fréquence. Cette valeur est saisie à l'aide du clavier et confirmée en appuyant sur la touche **OK**. L'appareil règle alors lui-même la valeur.

Exemple : réglage de la valeur fondamentale de fréquence 56.00
Après la mise en marche de l'appareil, l'option de menu « Direct » est active. Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

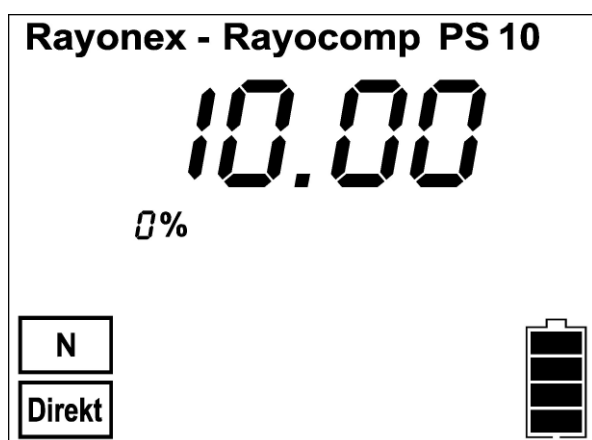

Remarque : Veuillez noter que, dans cet exemple, la saisie de la virgule est facultative. Ainsi, la saisie




est interprétée comme la valeur fondamentale de fréquence 6.00 par l'appareil Rayocomp PS 10.

Appuyez maintenant sur les touches suivantes :



L'appareil Rayocomp PS 10 règle alors la valeur fondamentale de fréquence sur 56.00 et affiche les éléments suivants à l'écran :

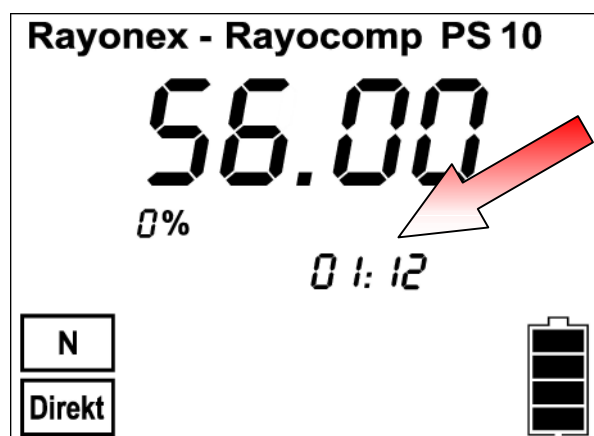

Sous la valeur fondamentale de fréquence s'affiche maintenant le temps qui s'écoule (dans l'exemple 1 minute et 12 secondes).

Procédez maintenant comme décrit dans le chapitre 4.2.1 et testez la valeur à l'aide du polarisateur ou harmonisez-la.

Vous pouvez régler à tout moment une nouvelle valeur fondamentale de fréquence.


4.2.3 Déroulement automatique d'un programme avec l'utilisation de la « Green-Card » RAH

Dans le chapitre 4.1.6, les avantages de la « Green-Card » RAH ont été décrits. L'option de menu « Direkt » permet l'utilisation d'une « Green-Card » RAH sur laquelle ont été enregistrés des valeurs de fréquences ou des programmes RAH, afin d'effectuer facilement le déroulement automatique d'une harmonisation.

Pour effectuer le déroulement automatique d'un programme dans l'option de menu « Direkt », procédez comme suit:

1. Mettez en marche l'appareil et connecter les détecteurs.
2. Insérer la « Green-Card » RAH préalablement enregistrée dans l'entrée prévue à cet effet.
3. Attendez jusqu'à ce que les données soient chargées, puis retirer la carte.
4. Le déroulement automatique d'harmonisation démarre.


D'abord, les valeurs fondamentales de fréquences enregistrées sur la « Green-Card » RAH seront réglées. Les éléments suivants s'affichent :

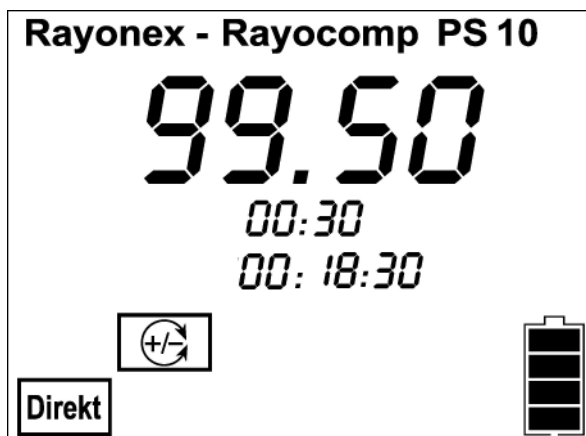

Une fois toutes les valeurs fondamentales réglées l'une après l'autre, le déroulement automatique d'harmonisation des programmes RAH chargés, avec leur durée respective d'harmonisation, démarre.

Si la « Green-Card » RAH ne contient que des programmes RAH, l'appareil Rayocomp PS 10 n'harmonise que des programmes RAH. Et pareil pour les valeurs fondamentales. Lors du

déroulement automatique d'harmonisation, les éléments suivants s'affichent :

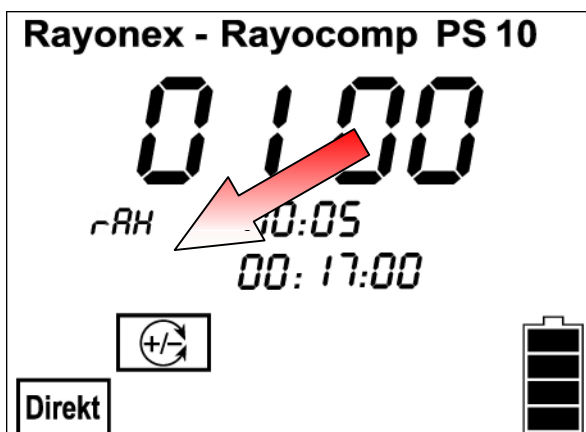

« rAH » est affiché pour qu'on sache tout de suite que des programmes RAH sont actuellement harmonisés.

Remarque : au moyen du Rayotensor, vous pouvez passer à la valeur fondamentale de fréquence suivante ou au programme RAH suivant, quand p. ex. le Rayotensor indique que l'harmonisation est déjà terminée.

4.3 Option de menu « F1 »

4.3.1 Informations de base concernant l'utilisation de programmes intégrés

L'introduction des appareils Rayocomp a permis en 1993 pour la première fois le réglage automatique de combinaisons de valeurs fondamentales de fréquences, donc de programmes d'harmonisation. Les premiers appareils Rayocomp PS 1000 disposaient déjà de 51 programmes d'harmonisation intégrés dans l'appareil. Plus tard, trois autres programmes sont venus s'y ajouter, qui sont encore valides aujourd'hui. Si un tel programme se compose par exemple de 100 différentes valeurs fondamentales de fréquences, un appareil Rayocomp PS 10 procède exactement 100 fois au réglage d'une valeur fondamentale de fréquence.

Les programmes d'harmonisation intégrés dans les appareils Rayocomp constituent en raison de leur simplicité d'utilisation une possibilité idéale pour bénéficier du potentiel de milliers de tests. Les programmes d'harmonisation comprennent les valeurs de résonance les plus courantes des plages de réglage. Si vous testez avec les appareils de biorésonance par ex. de nombreuses personnes présentant des problèmes de foie, la comparaison des points de résonance détectés apporte des fréquences d'apparition, qui ont également contribué au développement du plan de régulation. La structure au sein des programmes d'harmonisation est toujours identique. Les premières valeurs fondamentales de fréquences sont les valeurs de préréglage qui ont été prélevées dans le plan de régulation. Ensuite les programmes contiennent des valeurs fondamentales de fréquences du niveau physique, ainsi que des valeurs fondamentales de fréquences pathologiques des organes respectifs, suivies par une valeur (21.50) destinée à la stabilisation des polarités du corps.

Dans la pratique, l'utilisation des programmes d'harmonisation intégrés implique qu'en raison d'une position de diagnostic, par ex. à partir des résultats du Check-up (se reporter au chapitre 4.4.4), les organes particulièrement touchés puissent être harmonisés grâce à un programme intégré.

Outre les programmes thérapeutiques classiques de la biorésonance d'après Paul Schmidt, dans les appareils Rayocomp PS 10, l'option de menu « F1-RAH » propose également des programmes d'harmonisation du nouveau système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH). Pour cela, un équipement spécifique est nécessaire. Si votre Rayocomp PS 10 porte sur le côté l'inscription *Evolution*, le dispositif est déjà intégré dans l'appareil.

Dans le chapitre 4.3.5, vous trouverez des explications sur l'utilisation de ce nouveau système RAH.

4.3.2 Combinaison et harmonisation de différents programmes d'harmonisation

L'option de menu « F1-BnPS » est une fonction très performante des appareils Rayocomp PS 10, destinée à combiner et à harmoniser les programmes d'harmonisation intégrés dans l'appareil.

L'appareil Rayocomp PS 10 offre différents groupes de programmes d'harmonisation, qui figurent dans l'annexe (chapitre 5.2 à 5.5). En voici un aperçu global :

1.01 à 1.54: Programmes d'harmonisation Rayonex

2.01 à 2.14: Programmes d'harmonisation de la médecine d'acupuncture par fréquences

3.01 à 3.09: Programmes spéciaux

4.01 à 4.17: Programmes d'harmonisation selon Dr. Ulrich

La fonction « F1-BnPS » permet de combiner les programmes d'harmonisation issus des différents groupes. Il est ainsi possible de combiner le programme d'harmonisation 1.51, Prérégulation, avec le programme 3.02, Cicatrisation. L'appareil Rayocomp PS 10 réglerait alors automatiquement les valeurs fondamentales de fréquences de la prérégulation, et ensuite de la cicatrisation.

Avant de décrire en détail un exemple de réglage, voici quelques informations importantes concernant l'utilisation des programmes F1-BnPS:


- Jusqu'à 500 valeurs fondamentales de fréquences peuvent être combinées sous « F1-BnPS ». Si le premier programme dispose de 77 valeurs fondamentales de fréquences, et le second de 126 valeurs, cette combinaison comporte alors déjà 203 valeurs. Il est donc possible d'ajouter encore 297 valeurs supplémentaires.
- Lorsque différents programmes sont combinés, il est évidemment possible que certaines valeurs fondamentales de fréquences se répètent. Si vous souhaitez que les valeurs fondamentales de fréquences doubles ne soient systématiquement pas harmonisées, vous pouvez le régler dans la configuration sous l'option de menu 4.5.2. Ceci permet d'accélérer l'harmonisation. Le réglage standard autorise les valeurs d'harmonisation doubles. Le réglage « Suppression de valeurs doubles » est également valable pour les programmes RAH doubles.
- Tenez compte du fait que les différents groupes de programmes d'harmonisation indiqués ci-dessus doivent avoir été validés, c'est-à-dire que les modules correspondants ont dû être activés dans l'appareil Rayocomp PS 10. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 4.7.

L'exemple ci-dessous décrit comment combiner et harmoniser ensuite les programmes d'harmonisation 1.51 (prérégulation) et 1.52 (système immunitaire) sous « F1-BnPS ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche




jusqu'à ce que l'écran affiche l'option de menu « F1-BnPS »:

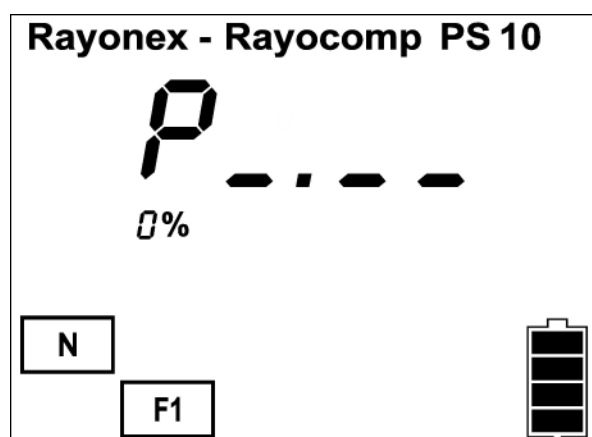

Vous pouvez alors saisir le numéro du premier programme d'harmonisation (1.51). Appuyez à cet effet sur les touches suivantes:



Les éléments suivants s'affichent à l'écran:

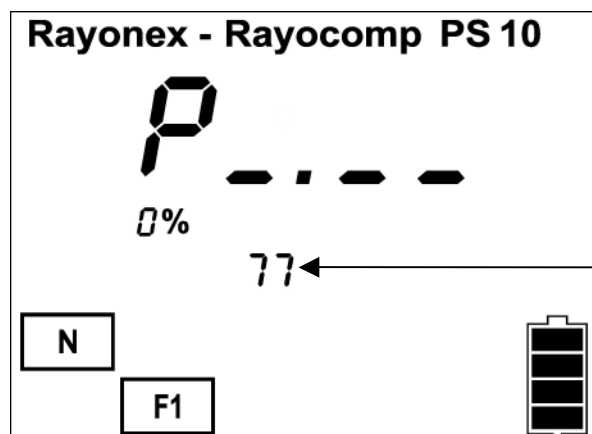


Remarque : ici vous verrez combien de valeurs fondamentales de fréquences ont déjà été chargées ; dans le cas présent, il s'agit de 77 valeurs.

L'appareil Rayocomp PS 10 est alors prêt pour la saisie du prochain programme d'harmonisation, dans l'exemple le programme 1.52. Appuyez à cet effet sur les touches suivantes:




Les éléments suivants s'affichent à l'écran:

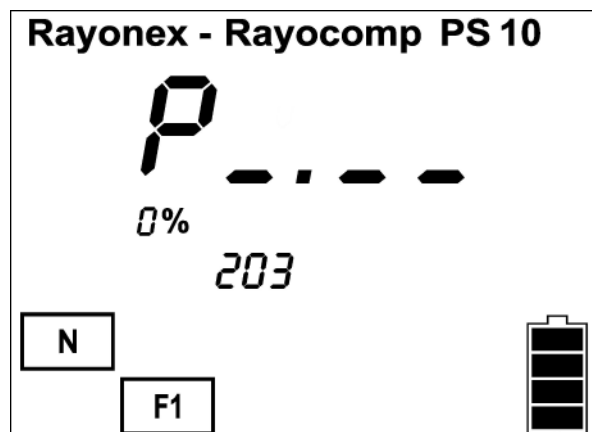

Comme les deux programmes d'harmonisation souhaités ont maintenant été saisis, appuyez sur la touche.

START

La durée d'harmonisation peut alors être indiquée sur l'écran. La valeur standard de l'appareil Rayocomp PS 10 est de 30 secondes. Vous pouvez toutefois modifier cette durée individuellement. Si vous souhaitez par exemple harmoniser chaque valeur fondamentale de fréquence pendant une minute et trente secondes, vous devez saisir les chiffres 01:30. Pour plus de facilité, l'appareil Rayocomp PS 10 calcule alors immédiatement la durée d'harmonisation totale et l'affiche dans la ligne en dessous (dans le cas présent, 1 heure, 41 minutes et 30 secondes).

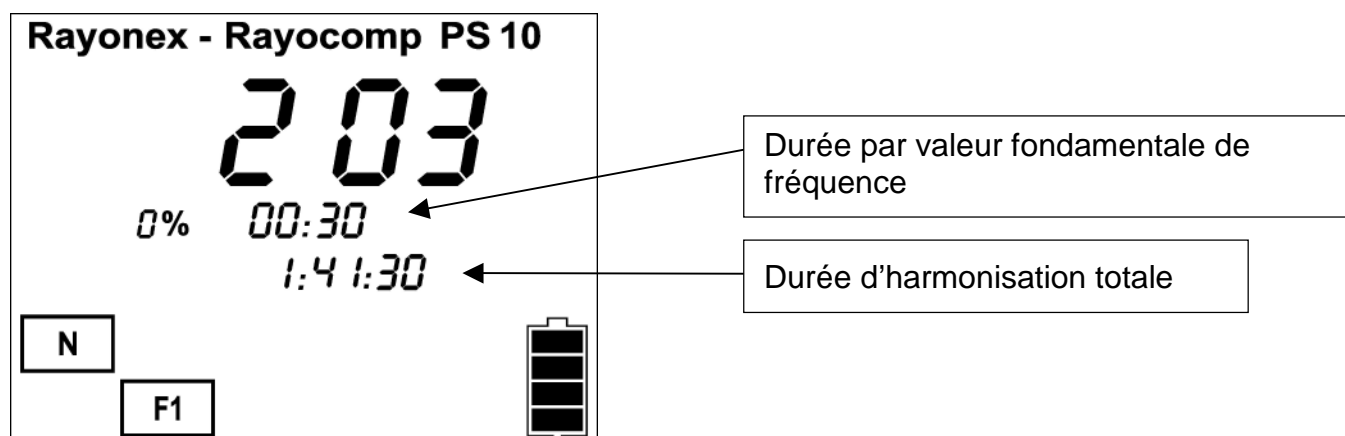

START

La touche **START** permet de démarrer le réglage automatique de toutes les valeurs. Le polarisateur va sur le +/-

STOP

La touche vous permet **STOP** d'interrompre le processus d'harmonisation (téléphone, ...) et la touche **START** de la poursuivre.


4.3.3 Charger les valeurs fondamentales de fréquences de la carte mémoire et les harmoniser

Comme décrit préalablement, l'option de menu « F1-BnPS » offre toutes les fonctions nécessaires à la combinaison de valeurs fondamentales de fréquences. L'utilisation de cartes mémoire, notamment de la « Green-Card » RAH, en fait naturellement partie. Si vous avez par exemple enregistré les valeurs de résonance d'un test de valeurs dans une plage sur une carte mémoire, vous pouvez les harmoniser automatiquement sous «F1-BnPS».


Sélectionnez à cet effet l'option de menu « F1 » à l'aide de la touche



Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

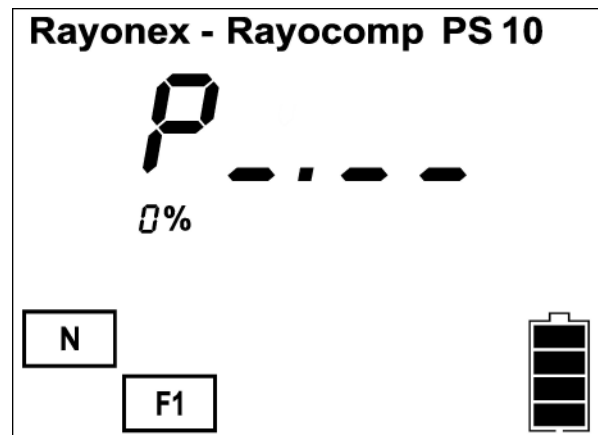

Insérez maintenant la carte mémoire dans l'appareil Rayocomp PS 10 et

appuyez sur la touche suivante: 

Les valeurs mémorisées sur la carte sont alors transférées à l'appareil Rayocomp PS 10 et sont disponibles pour l'harmonisation.

Conseil n° 1: Vous pouvez combiner les valeurs d'un programme intégré et celles issues d'une carte mémoire. Vous pouvez donc par exemple enregistrer d'abord le programme 1.51, puis celui issu de la carte mémoire, suivi d'un autre programme.

Conseil n° 2: Vous pouvez créer vous-même des cartes mémoire dans l'option de menu « Configuration ». Reportez-vous à ce sujet au chapitre 4.5.7.


4.3.4 Prise en charge et harmonisation des valeurs fondamentales de l'option de menu « Tester »

Lorsque vous avez déterminé des valeurs de résonance dans l'option de menu « Tester », vous pouvez les utiliser après un changement directement dans l'option de menu « F1 ». Saisissez à cet effet les chiffres 0.00 sous « F1 ». Il est cependant conseillé d'enregistrer toujours les valeurs de résonance sur une carte mémoire, et de lire celles-ci ensuite dans l'option de menu « F1 ».

4.3.5 Utilisation des programmes d'harmonisation du système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH)


Le module RAH a été inclus dans l'option de menu « F1 », tout comme les programmes intégrés. Pour faciliter l'utilisation des différents modules, deux sous-menus séparés ont été créés (BnPS et RAH). On peut également accéder aux deux sous-menus par la touche « Mode ». Vous trouverez les descriptifs de programmes ainsi que les numéros de programmes dans les éditions spéciales d'« Impuls ».

Appuyez plusieurs fois sur la touche « Mode » jusqu'à ce que l'écran affiche l'option de menu « F1-BnPS » :

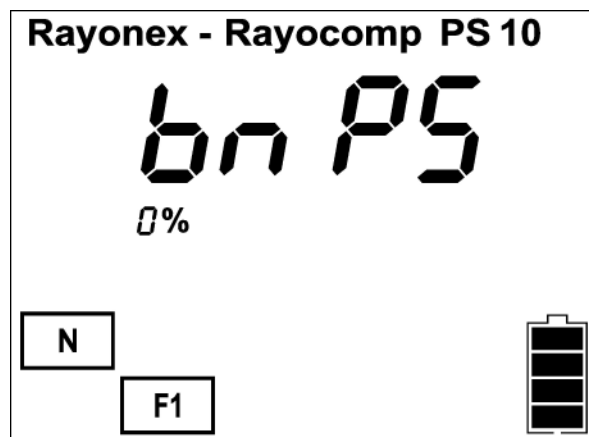


Remarque : Le système d'analyse et d'harmonisation (RAH) ne marche que si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Au cas où vous l'avez oublié, le message d'erreur « Er 40 » vous le rappellera. En retirant la carte, la transmission démarrera automatiquement.

L'affichage « bnPS » en haut de l'écran vous indique le sous-menu BnPS. En appuyant encore une fois, vous passez au module RAH. Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

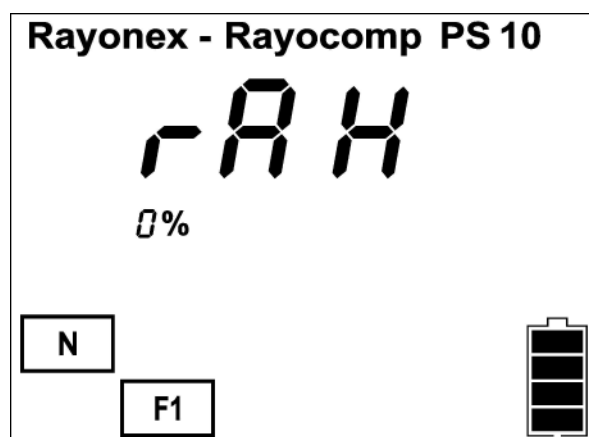

« rAH » est l'affichage simplifié de « RAH » et indique dans le cas précis l'harmonisation avec le système d'analyse et d'harmonisation. Si on n'appuie pas une deuxième fois, l'affichage passe à la demande de saisie du module RAH.


Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

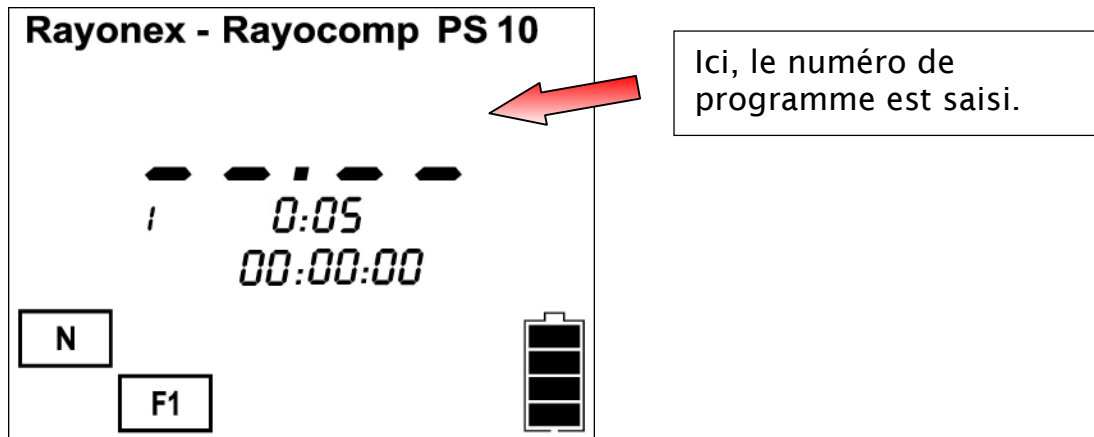

L'appareil Rayocomp PS 10 attend maintenant la saisie d'un numéro de programme. Dans le cas précis, les programmes « Vitalisation (l'ensemble) » et « Voies respiratoires supérieures » devraient être saisis. Dans les listes de programmes respectives, vous trouverez le numéro 01.00 qui correspond au programme « Vitalisation (l'ensemble) » et le numéro 70.16 qui correspond au programme « Voies respiratoires supérieures ». Pour établir le processus d'harmonisation avec ces programmes, vous appuyez sur les touches suivantes :




Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

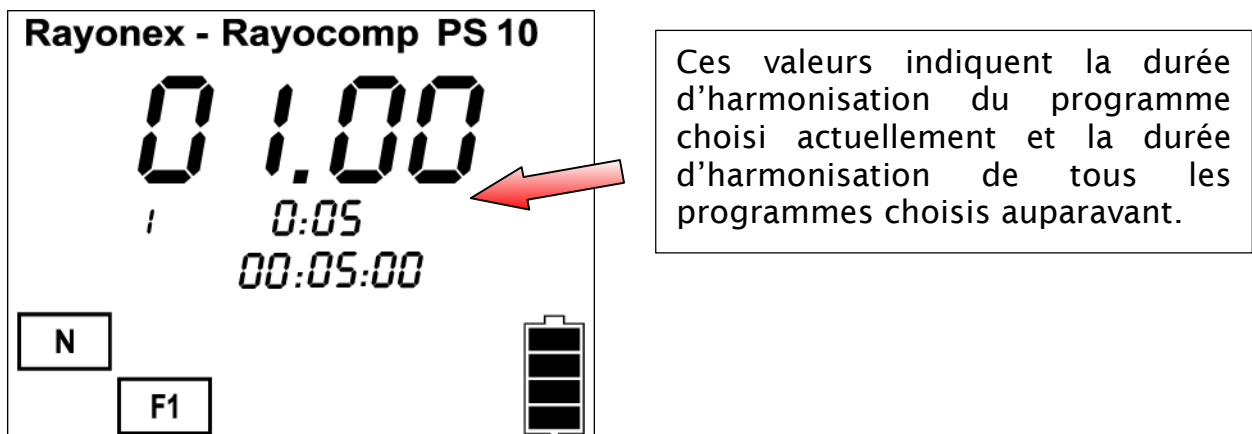


Dans la prochaine étape, la durée d'harmonisation peut être réglée. Une durée de 5 minutes est déjà pré-réglée. Cette valeur peut être confirmée avec la touche OK. Ou bien, on peut modifier la durée en changeant les minutes. Si on modifie la durée, la nouvelle valeur sera prise en compte comme la nouvelle valeur standard par la suite. Ceci facilite la saisie pour l'utilisateur si une autre durée d'harmonisation, différente de la durée de 5 minutes, est souhaitée.

Si vous souhaitez augmenter la durée à 15 minutes, p. ex., l'affichage changera et indique les éléments suivants :

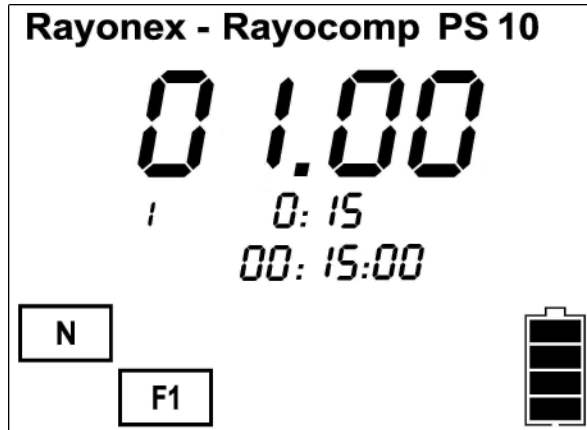

L'harmonisation du premier programme a maintenant une durée de 15 minutes. La durée totale de l'harmonisation est de 15 minutes également, car un seul programme a été choisi jusqu'à présent. La saisie de la durée doit être confirmée par la touche OK.


L'affichage suivant montre la suite du processus. Le deuxième programme peut être réglé maintenant. Le fait qu'il s'agit du deuxième programme est indiqué par le chiffre 2 devant la durée d'harmonisation. :

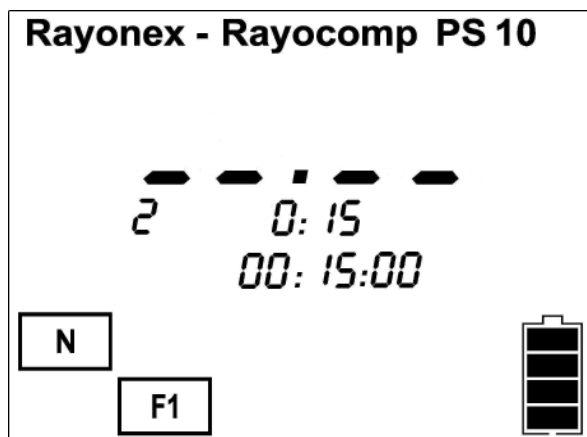


Afin de choisir le programme « Voies respiratoires supérieures », le numéro 70.16 doit être saisi :



Après avoir confirmé la saisie avec la touche OK, la durée totale change. La durée totale est la somme de toutes les durées d'harmonisation déjà choisies plus la durée d'harmonisation actuelle du programme « Voies respiratoires supérieures ».

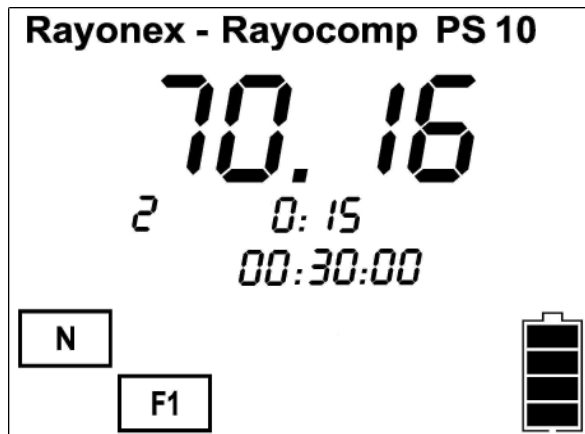

Si le programme 70.16 soit également être harmonisé pendant 15 minutes, il suffit d'appuyer sur la touche OK pour confirmer.

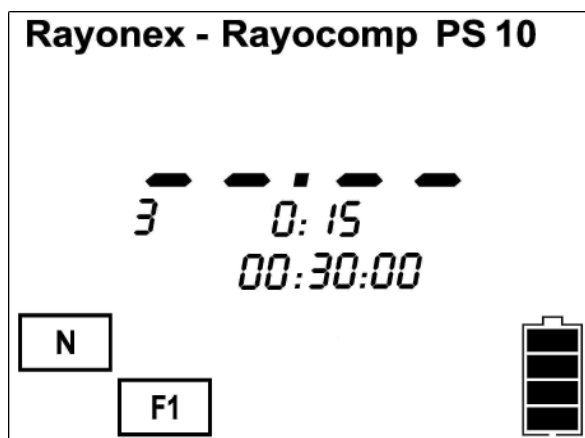

Si tous les programmes ont été choisis, l'harmonisation peut démarrer, en appuyant sur la touche « Start ».

Le premier programme est maintenant chargé. L'affichage du pourcentage indique la progression. Quand les 100% sont atteints, le polarisateur passe à la position +/- , et la durée d'harmonisation commence, en comptant en arrière. La durée totale d'harmonisation est actualisée toutes les secondes, par contre, la durée d'harmonisation en cours est actualisée toutes les minutes. Le numéro de programme s'affiche à l'écran.

Quand vous utilisez le module RAH, assurez-vous qu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil. Si cela devait arriver quand même, l'affichage d'erreur « Er 40 » vous indique de retirer la carte. Ceci est valable pour tout type de carte.

Fonction de pause et fin de l'harmonisation

En appuyant une fois sur la touche « Stop », la durée d'harmonisation est arrêtée.

En appuyant sur la touche « Start », la durée d'harmonisation redémarre. Pour terminer l'harmonisation et réinitialiser le module RAH, on appuie deux fois sur la touche « Stop ».

Répéter ou avancer les programmes RAH

Dans une liste de programmes saisis, on peut choisir directement un programme en utilisant les touches « Flèches ».

On passe au programme suivant en appuyant sur la touche « Flèche de droite » ou en déplaçant le bouton du Rayotensor vers la droite. En appuyant sur la touche « Flèche de gauche » ou en déplaçant le bouton du Rayotensor vers la gauche, on passe au programme d'harmonisation précédant.

Le déroulement des programmes correspond à l'ordre dans lequel les programmes ont été choisis. En appuyant une fois sur la touche « Flèche de gauche » (ou en déplaçant une fois le bouton du Rayotensor à gauche), on redémarre la durée d'harmonisation du programme actuel. C'est seulement en appuyant une deuxième fois sur la touche « Flèche de gauche » (ou en déplaçant une deuxième fois le bouton du Rayotensor à gauche) qu'on passe au programme précédent.

Tester un programme RAH au moyen du Rayotensor

Les programmes d'harmonisation disponibles dans l'appareil Rayocomp PS 10 ne servent pas seulement à harmoniser mais également à tester.

Pour cela, on choisit un programme d'harmonisation comme décrit auparavant et on appuie sur la touche « Start ». Une fois le programme chargé, on peut tester avec le Rayotensor s'il est nécessaire d'harmoniser ou non. Pour ceci, on règle le polarisateur sur la position neutre N. Une rotation du Rayotensor indique qu'une harmonisation n'est pas nécessaire. Par contre, un mouvement linéaire indique qu'une harmonisation est utile. En déplaçant le bouton du Rayotensor vers le bas, on peut tester les polarités afin de savoir si la perturbation est importante ou plutôt faible.


Si une harmonisation s'avère utile, on note le numéro et on passe au programme suivant en appuyant deux fois sur la touche « Stop ». Ensuite, on peut choisir le prochain programme d'harmonisation à tester.

Veillez noter que le module 8 du RAH ne contient qu'une sélection des programmes d'harmonisation disponibles. Uniquement les modules 9 et 10 contiennent la totalité des programmes RAH. Les fonctions du module M10 sont décrites en détail dans les chapitres 4.4.5 à 4.4.8.

4.4 Option de menu « Tester »

L'option de menu « Tester » offre à l'utilisateur un grand nombre de fonctions lui permettant de tester des valeurs fondamentales de fréquences. Tester signifie dans ce contexte, déterminer si la valeur de fréquence respective doit être harmonisée ou non. Le processus de test est déjà décrit plus en détail dans le chapitre 4.2.1. Lorsqu'il est nécessaire de tester des valeurs fondamentales de fréquences individuelles, le plus simple est de procéder sous l'option de menu « Direct » comme nous l'avons décrit préalablement. L'utilisation de l'option de menu « Tester » est conseillée lorsqu'un grand nombre de valeurs fondamentales de fréquences doivent être testées en séquence rapide. Le test d'une pollution par électrosmog par exemple comporte six valeurs fondamentales de fréquences à tester. Pour procéder sous l'option de menu « Direct », il serait alors nécessaire de saisir les six valeurs les unes après les autres, ce qui ne serait pas très confortable. Si cependant on sélectionne dans l'option de menu « Tester » un programme de test activé, par ex. « Electrosmog », les six fréquences de ce programme sont déjà enregistrées dans l'appareil et il n'est plus nécessaire de les saisir. Après le test de la première valeur de fréquence, vous devez commuter à la prochaine valeur de programme respective. Ceci est possible à l'aide du clavier (touche « flèche de droite ») ou au moyen du Rayotensor (bouton vers la droite). L'appareil règle alors automatiquement la valeur de test sélectionnée. Les résonnances déterminées peuvent être enregistrées dans la mémoire intermédiaire interne de l'appareil à des fins d'harmonisation ultérieure. A cet effet, il suffit d'appuyer sur la touche **OK** du clavier ou de pousser le bouton du détecteur vers l'avant. Les valeurs enregistrées dans la mémoire intermédiaire peuvent ensuite être harmonisées à l'aide du numéro de programme P0.00 sous l'option de menu "F1-BnPS" (se reporter au chapitre 4.3.4)


Alternativement, les valeurs peuvent être enregistrées sur une carte mémoire à l'aide de la touche



Les paragraphes ci-dessous décrivent comment ouvrir les programmes de test.



Sélectionnez l'option de menu « Tester » à l'aide de la touche

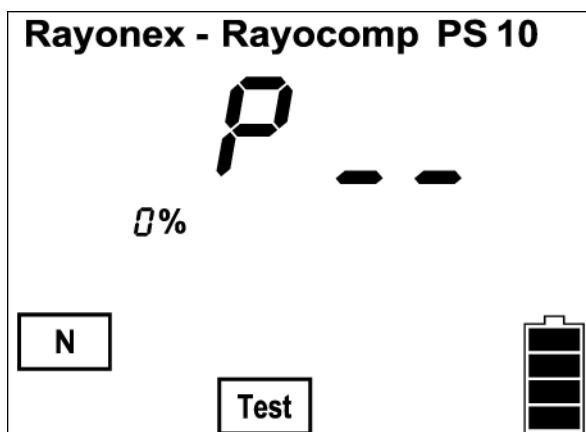

Tout comme l'option de menu « F1 », l'option de menu « Tester » est également divisée en deux parties : « BnPS » et « RAH ». L'option de menu « RAH » ne peut être choisie si le module M10 est activé.

Saisissez maintenant le numéro du programme BnPS de test respectif. Vous trouverez la liste correspondante sur la prochaine page.

Affichage	Nom du programme
P 01	Test de valeurs dans une plage
P 02	Test avec des valeurs de carte mémoire
P 03	Test avec des programmes intégrés
P 04	Test d'électrosmog
P 05	Test de géopathie
P 06	Test de check-up
P 07	Test de bactéries et de virus
P 08	Test de parasites
P 09	Test d'acides et de bases
P 10	Test rapide des 14 méridiens
P 11	Test de substances vitales

Si vous saisissez par ex. le 01, vous pouvez effectuer un test de valeurs dans une plage, le 02 vous permet de lire et de tester les valeurs fondamentales de fréquences issues d'une carte mémoire. Si vous entrez le 03, vous pouvez tester les programmes intégrés, dans la mesure où ils sont intégrés via les modules. Les programmes de test de 04 à 11 constituent des combinaisons spéciales de valeurs fondamentales de fréquences qui peuvent être utilisées lorsque le module 6, programmes de test, est intégré dans l'appareil Rayocomp PS 10.

Remarque importante:


A tout moment, les valeurs fondamentales de fréquences testées par résonance peuvent être enregistrées à l'aide de la touche



sur une carte mémoire enfichée. Vous pouvez donc par exemple lire et tester les valeurs fondamentales de fréquences d'une carte mémoire, et ensuite mémoriser les résonances déterminées sur la même carte. Ceci est particulièrement adapté lorsque les résonances d'un test de valeurs dans une plage sont retestées. N'oubliez pas qu'en appuyant sur la touche, toutes les valeurs sur la carte sont écrasées.

Le numéro de programme définit donc les valeurs fondamentales de fréquences à tester. Une fois que ces valeurs sont disponibles pour le test, le déroulement du test est toujours identique.

Si vous choisissez par exemple le test de valeurs dans une plages, l'écran affiche alors les éléments suivants:

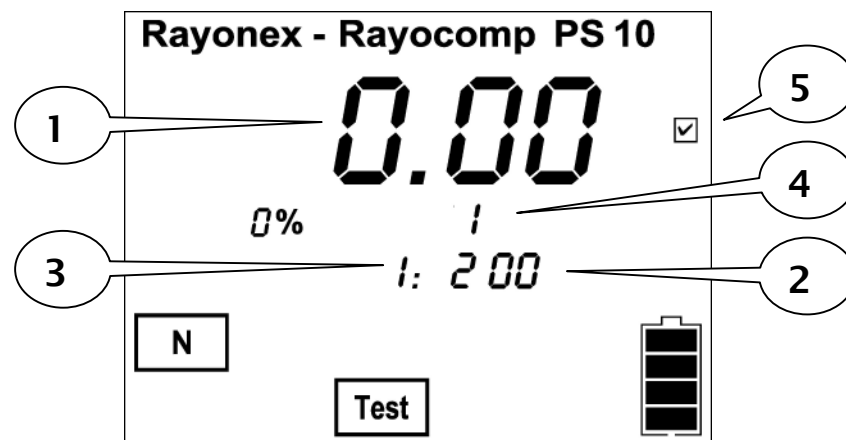

L'appareil Rayocomp PS 10 vous informe via cet écran quelle est la valeur fondamentale de fréquence qui peut être testée actuellement (1), combien de valeurs fondamentales de fréquences doivent être testées en tout (2), quelle est par ordre chronologique la valeur fondamentale de fréquence en cours de test (3), combien de valeurs fondamentales de fréquences ont obtenues une résonance (4) et si la valeur fondamentale de fréquence actuellement affichée à l'écran est une valeur de résonance (5).

Le Rayotensor vous permet de tester maintenant s'il existe une résonance et si celle-ci est forte ou faible (comparez avec le chapitre 4.2.1). Un atout particulièrement pratique de ce test est la possibilité de régler la prochaine valeur à l'aide du Rayotensor ou de l'enregistrer (comparez avec le chapitre 4.1.5).

4.4.1 Test de valeurs dans une plages

L'objectif sur lequel repose ce test est de déterminer l'ensemble des valeurs fondamentales de fréquences à harmoniser actuellement, de les enregistrer et de les harmoniser. Les appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt permettent de réaliser un test de résonance sur une plage étendue de valeurs fondamentales de fréquences. En pratique, le test débute avec la valeur fondamentale de fréquence 0.00, afin de définir si cette valeur est nécessaire à la régulation. Si oui, elle est enregistrée dans l'appareil Rayocomp PS 10. Ensuite, la valeur fondamentale de fréquence 0.50 est testée, puis la valeur 1.00 et ainsi de suite.

Après le test, les valeurs de résonance nécessaires à l'organisme du patient à des fins de régulation ont été déterminées avec précision. Le spectre de résonance déterminé représente alors pour ainsi dire l'empreinte énergétique.

La complexité des valeurs fondamentales de fréquences trouvées reflète la complexité de la maladie. C'est pourquoi une première mesure ne permet normalement pas l'établissement d'un diagnostic. Les valeurs de résonance sont plutôt utilisées pour une harmonisation.

Dans ce cadre, les valeurs fondamentales de fréquences sont transmises à la personne testée via les détecteurs de main et de pied ou les détecteurs bracelets. Une autre possibilité est le transfert des fréquences à l'aide d'un grand détecteur de surface, par ex. la nuit pendant le sommeil.

Voici comment réaliser le test de valeurs dans une plage:

Sélectionnez l'option de menu « Tester » à l'aide de la touche .

Saisissez conformément au tableau (chapitre 4.4) le numéro 01 et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **OK**. La valeur de départ du test s'affiche. Si vous êtes d'accord, confirmez la valeur en appuyant sur la touche **OK**. Ensuite, l'appareil affiche la valeur finale, que vous devrez également confirmer à l'aide de la touche **OK**. Finalement, vous pouvez modifier l'intervalle de mesure indiqué ou le confirmer à l'aide de la touche **OK**. Nous conseillons de sélectionner 0.00 comme valeur de départ, 99.99 comme valeur finale et 0.50 comme intervalle. Vous définissez ainsi 200 valeurs à tester. Testez ensuite comme décrit préalablement les valeurs fondamentales de fréquences quant à leur résonance.

4.4.2 Test avec des valeurs de carte mémoire

L'appareil Rayocomp PS 10 offre la possibilité très appréciable de sauvegarder des valeurs fondamentales de fréquences sur une carte mémoire. Les valeurs qui y sont mémorisées peuvent ensuite être utilisées à des fins d'harmonisation sous l'option de menu « F1 ». Les valeurs figurant sur cette carte peuvent également être utilisées à des fins de test. Voici comment cela fonctionne :

Sélectionnez l'option de menu « Tester » à l'aide de la touche .

Insérez la carte mémoire et saisissez le numéro 02, conformément au tableau en chapitre 4.4. L'appareil Rayocomp PS 10 charge alors les valeurs de la carte et passe au mode de test déjà affiché.

4.4.3 Test avec des programmes intégrés

Outre les cartes mémoire qui représentent des combinaisons presque individuelles de valeurs fondamentales de fréquences, l'appareil Rayocomp PS 10 vous permet également de tester les programmes intégrés en fixe. Exemple : si vous avez intégré dans l'appareil Rayocomp PS 10 les programmes pour la thérapie d'acupuncture par fréquences, vous pouvez tester l'ensemble d'un méridien, par exemple le méridien des reins.

A cet effet, procédez comme suit:

Sélectionnez l'option de menu « Tester » à l'aide de la touche .

Saisissez conformément au tableau (chapitre 4.4) le numéro 03 et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **OK**. Sélectionnez ensuite le programme que vous souhaitez tester. Dans ce cas, saisissez sur l'écran le numéro 2.08 pour le méridien des reins (comparez avec le chapitre 5.3). Testez ensuite les valeurs fondamentales de fréquences correspondantes.


N'oubliez pas que vous ne pourrez tester que les programmes qui ont aussi été intégrés en tant que modules. Si le module de thérapie d'acupuncture par fréquences n'est pas intégré, les programmes correspondants ne pourront pas être testés.

4.4.4 Test avec des programmes de test intégrés

Outre les programmes intégrés, il existe également une combinaison de programmes de test qui sont utilisés très fréquemment. Pour plus de facilité, nous les avons regroupés encore une fois ci-dessous.

Affichage	Nom du programme
P 04	Test d'électrosmog
P 05	Test de géopathie
P 06	Test de check-up
P 07	Test de bactéries et de virus
P 08	Test de parasites
P 09	Test d'acides et de bases
P 10	Test rapide des 14 méridiens
P 11	Test de substances vitales

Si vous souhaitez par exemple réaliser un test d'électrosmog, procédez comme suit:

Sélectionnez l'option de menu « Tester » à l'aide de la touche . Saisissez ensuite le numéro 04 et confirmez la saisie en appuyant sur la touche **OK**. L'écran affiche alors les six valeurs fondamentales de fréquences principales nécessaires au test d'électrosmog.

Ici aussi nous vous rappelons que vous ne pouvez effectuer les programmes de test 04 à 10 que si le module 6 correspondant (comparez avec le chapitre 5.7) a été intégré à l'appareil Rayocomp PS 10.


4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux

Informations sur le module RAH M10

Dans le Rayocomp PS 10, le module M10 représente le module le plus élaboré. Par rapport au module M9, il contient en plus d'importantes fonctions de test. Sa spécificité absolue : dans le module M10, vous pouvez activer, par simple appui de bouton, tous les programmes RAH pour l'analyse, sans saisir un par un tous les numéros des programmes. Les résultats de test sont disponibles pour l'harmonisation ainsi que l'enregistrement sur la « Green-Card » RAH. Dans le module M10, on retrouve, comme dans le Rayocomp PS polar, le test de niveaux. Quand on choisit un programme RAH principal, on peut, en appuyant sur le bouton du Rayotensor, aller dans les programmes RAH inférieurs pour tester. Si vous utilisez déjà un module RAH dans votre Rayocomp PS10, vous avez la possibilité d'une mise à jour pour intégrer un module plus élaboré, comme p.ex. une mise à jour du module M9 au module M10.

Le test de niveaux

Le Rayocomp PS 10 assiste déjà l'utilisateur très efficacement lors de l'analyse des perturbations énergétiques. Par l'intermédiaire du test de niveaux, par exemple, on étudie au plus près l'électrosmog. Si l'on constate une perturbation générale provoquée par l'électrosmog (programme RAH 04.00), on peut affiner le résultat par le second niveau, afin de déterminer si les problèmes sont liés aux champs électromagnétiques (programme RAH 04.10), au rayonnement modulé par impulsions (programme RAH 04.20) ou au rayonnement énergétique fort (programme RAH 04.30). S'il y a un problème au niveau du rayonnement modulé par impulsions par exemple, on peut passer au troisième et dernier niveau, celui des détails, et y tester les spectres de fréquences des nuisances provoquées par radiocommunication mobile, UMTS, Wifi ou par exemple Bluetooth. Cette structure en niveaux se déroule comme un fil rouge tout au long du RAH (causes, physiologie, pathologie, programmes spéciaux comme les fleurs de Bach, les sels de Schüssler, etc.) et permet d'obtenir des informations sur les perturbations énergétiques et tester rapidement et efficacement les spectres de fréquences à harmoniser.

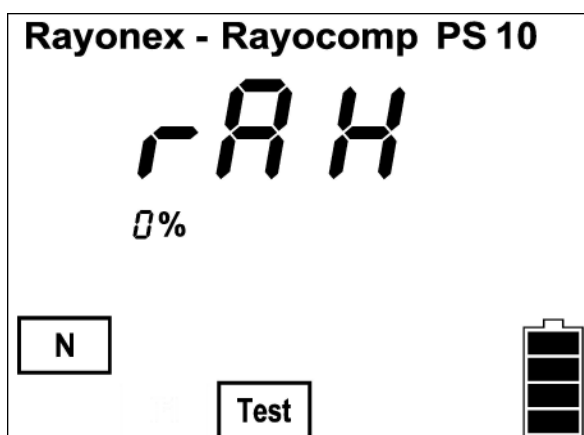

Si le module M10 est activé, appuyez sur la touche

MODE


plusieurs fois jusqu'à ce que les éléments ci-contre s'affichent sous l'option de menu « Tester ». « rAH » s'affiche à l'écran, ce qui indique vous pouvez maintenant procéder au test de programmes RAH.

Après quelques secondes, l'affiche change et passe à la demande de saisie des programmes RAH.

Appuyez maintenant sur les touches suivantes :



L'appareil Rayocomp PS 10 choisit maintenant le programme RAH 04.00 et affichent les éléments suivants :

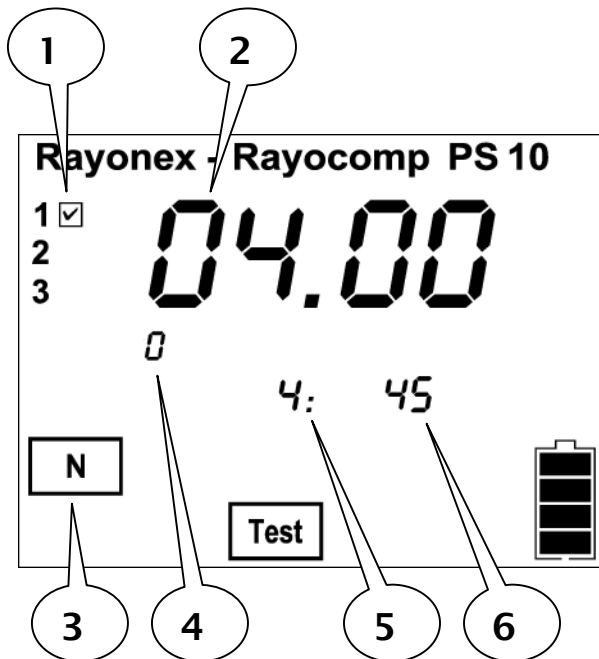


Le programme RAH 04.00 (2) est un programme principal, ce qui est indiqué par le niveau 1 (1). Dans ce cas précis, les niveaux 2 et 3 sont également affichés pour indiquer à l'utilisateur qu'il existe dans ce programme principal d'autres programmes détaillés correspondants.


niveau.

Au premier niveau, 45 programmes sont à disposition (6). Le programme 04.00 est le quatrième programme (5) des 45 programmes du premier

Pour le test, l'appareil Rayocomp PS 10 règle le polarisateur automatiquement sur la position neutre N (3). Actuellement, aucun programme à harmoniser a été marqué (4).

Le test peut être démarré au moyen du Rayotensor relié à l'appareil. Voici l'aperçu des différentes fonctions :

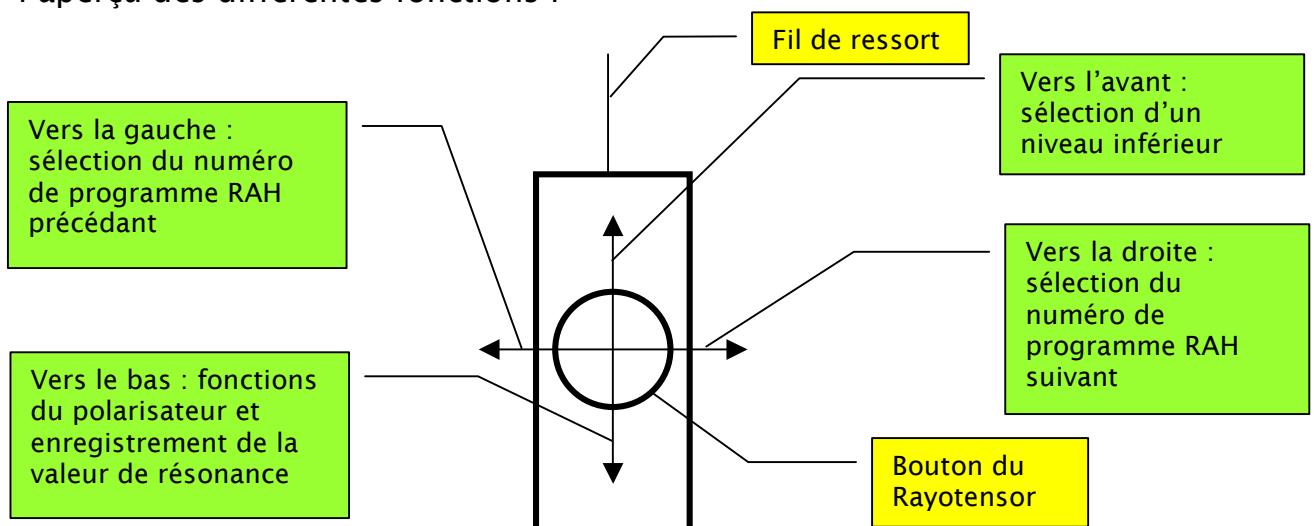

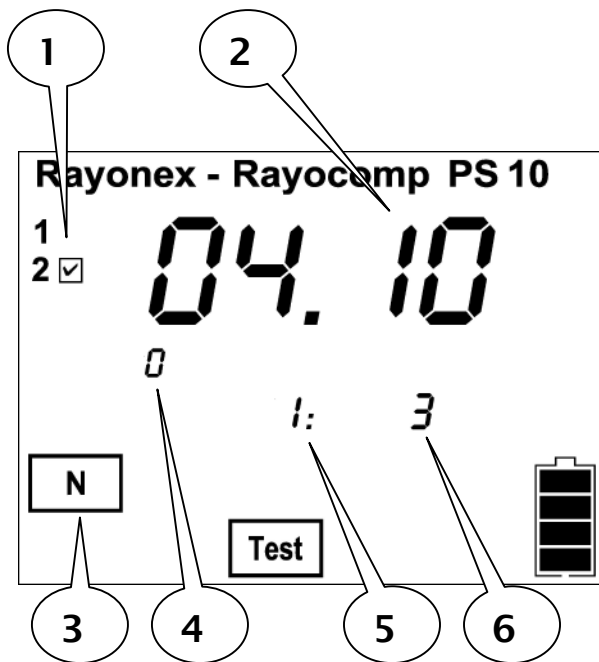


En déplaçant le bouton du Rayotensor vers l'avant, l'appareil passe au deuxième niveau (1). Le sous-programme 04.10 s'affiche (2). Le fait que le troisième niveau n'est pas affiché, indique que le programme 04.10 ne contient pas de sous-programmes.


Au deuxième niveau indiqué, 3 programmes sont à disposition (6). Le programme 04.10 est le premier programme (5) des 3 programmes du deuxième niveau.

Pour le test, l'appareil Rayocomp PS 10 règle le polarisateur automatiquement sur la position neutre N (3). Actuellement, aucun programme à harmoniser a été marqué (4).

Si le Rayotensor montre un mouvement linéaire lors du test, vous pouvez marquer le programme actuel à harmoniser en déplaçant le bouton du Rayotensor vers le bas. Ceci est indiqué sur l'écran par le crochet (7). Le compteur des valeurs enregistrées (4) marque maintenant le chiffre 1.

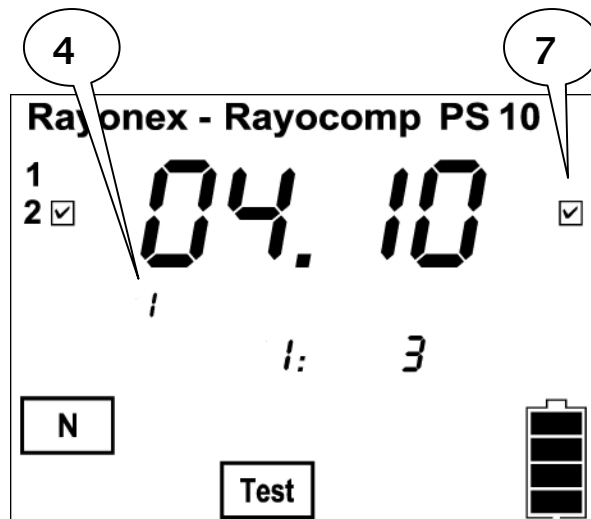


Si vous déplacez maintenant le bouton du Rayotensor vers la droite, le prochain programme RAH sera sélectionné (04.20). L'écran affiche alors les éléments suivants :

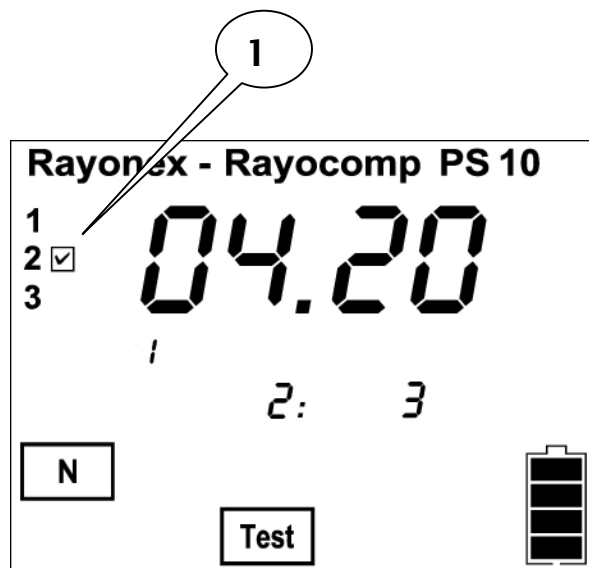

A gauche de l'écran, il est indiqué que le programme 04.20 contient d'autres programmes détaillés (1), signalé par le 3 (pour le troisième niveau).

Si vous déplacez le bouton du Rayotensor vers l'avant, le premier programme détaillé 04.21 sera sélectionné (2). Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

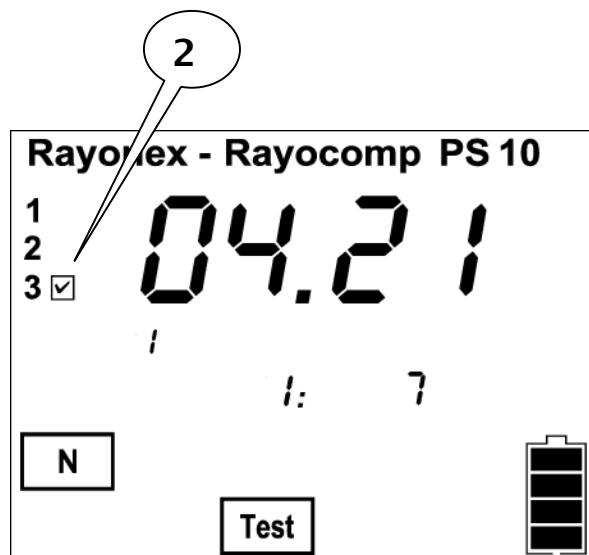

Le programme RAH 04.21 est le premier programme des 7 programmes détaillés contenu dans le programme RAH 04.20 qui est à son tour contenu dans le programme principal 04.00.

De cette manière, décrite dans ce chapitre, vous pouvez tester avec l'appareil Rayocomp PS 10 toute la structure des programmes RAH et enregistrer les programmes qui ont

besoin d'être harmonisés. Pour cela, vous pouvez choisir un niveau principal ou bien démarrer « au milieu ». Si vous aviez sélectionné tout de suite au début le programme RAH 04.21, l'écran aurait affiché les mêmes éléments.

Nous vous recommandons d'utiliser pendant le test l'édition spéciale RAH de la revue « Impuls » publiée par l'Association pour la Promotion de la Médecine vibratoire.

Très important :

Veuillez lire aussi le chapitre :


4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10

Les conseils d'utilisation que vous trouverez ici vous faciliteront le travail avec le module M10 !

4.4.6 Module RAH 10 : test avec des protocoles de test intégrés

L'idée est née dans notre école de naturopathie. On y apprend notamment quelles structures d'organes et quels domaines de régulation sont à prendre en compte pour telle ou telle maladie. Ceci s'applique aussi aux tests énergétiques par le RAH. Ainsi, p.ex., en cas d'une hypertonie (tension artérielle élevée), il faudrait tenir compte des reins qui produisent la rénine, l'enzyme qui augmente la tension. Mais aussi, le système hormonal, car il a une grande influence sur le métabolisme et la tension. Et tous ces liens sont pris en compte dans le nouveau soutien d'analyse. Si on choisit p. ex. les spectres de fréquences du programme RAH 39.60 Hypertension, on peut obtenir directement, en appuyant sur un bouton, les programmes RAH à tester correspondant à cette affection. Cela peut donner parfois plus de 100 programmes différents.


Un programme RAH, pour lequel un protocole de test est disponible, est signalé à droite de l'écran par le chiffre 10 (1) :

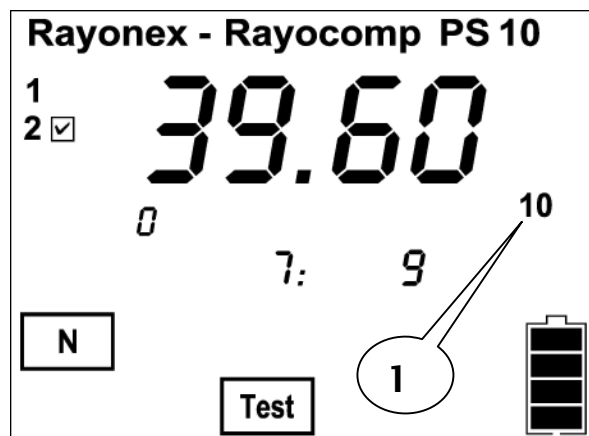

Ainsi, vous pouvez voir immédiatement qu'un protocole de test peut être sélectionné. Celui-ci peut être activé par la touche

10,0

L'écran affiche ensuite les programmes RAH du protocole de test. En appuyant sur la touche « Stop », vous pouvez à tout moment quitter le protocole de test.

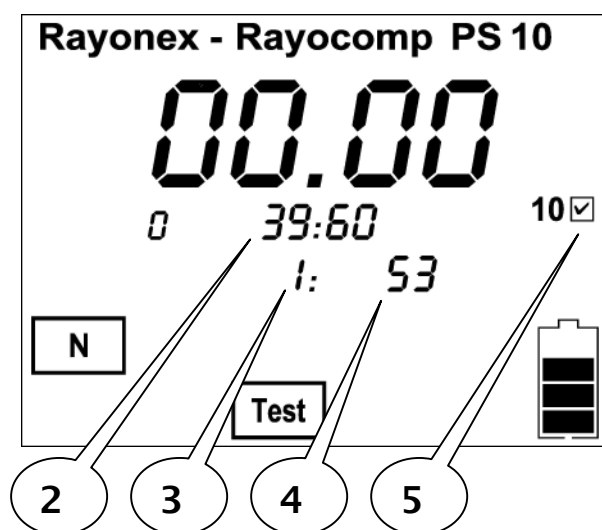

Après l'activation du protocole de test, un crochet (5) s'affiche à l'écran derrière le chiffre 10 ce qui indique le protocole de test actif. Au milieu de l'écran, le numéro du protocole de test s'affiche (2), dans ce cas précis le programme 39.60. Les positions (3) et (4) signalent que le programme RAH actuel est le premier programme des 53 programmes RAH du protocole. Vous pouvez procéder maintenant - comme décrit au chapitre 4.4.5 - au test et à l'enregistrement de tous les programmes RAH correspondants.


Veuillez lire aussi le chapitre :

4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10


4.4.7 Module RAH 10 : test avec la « Green-Card » RAH

Avec le module M10 du Rayocomp PS 10, il est possible non seulement d'utiliser les programmes RAH enregistrés sur la « Green-Card » RAH pour une harmonisation, mais aussi pour l'analyse. On pourrait par exemple utiliser les programmes RAH trouvés lors de l'analyse précédant et enregistrés sur la « Green-Card » RAH pour un nouveau test. Il est également envisageable de choisir ses propres combinaisons de programmes RAH et de les enregistrer sur la « Green-Card » RAH pour les tester ensuite.

Insérez une « Green-Card » RAH enregistrée dans l'appareil Rayocomp PS 10 et appuyez sur la touche suivante :



L'appareil Rayocomp PS 10 charge maintenant les programmes RAH contenus sur la carte et les met à disposition pour le test. A l'écran s'affichent par exemple les éléments suivants :

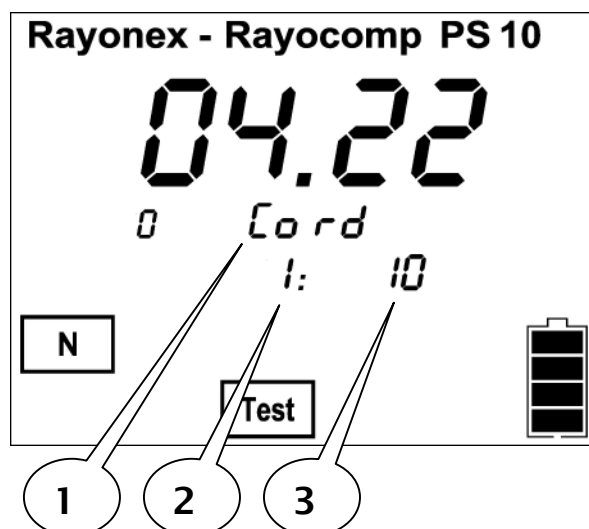

Le programme RAH actuellement sélectionné est le programme 04.22. Il est le premier programme (2) des 10 programmes RAH (3) à tester.

Sur l'écran apparaît la mention « Card » (1) qui signale à l'utilisateur qu'il teste actuellement des valeurs d'une « Green-Card » RAH.

Vous pouvez procéder maintenant – comme décrit au chapitre 4.4.5 – au test et à l'enregistrement de tous les programmes RAH correspondants.

Veuillez lire aussi le chapitre :

4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10

4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10

Les conseils donnés ici s'appliquent tant au test de niveaux (chapitre 4.4.5) qu'au test avec des programmes intégrés (chapitre 4.4.6) et au test avec la « Green-Card » RAH (chapitre 4.4.7).


1. Les signaux sonores

A chaque fois que l'appareil sélectionne un programme RAH à tester, il émet deux sons courts qui indiquent que le programme est complètement chargé et à disposition pour le test.

Quand un programme RAH a été enregistré en tant que résonance trouvée, vous entendez un son prolongé. L'appareil confirme ainsi l'enregistrement achevé avec succès.

Les signaux sonores sont utiles, car l'utilisateur n'a pas besoin de regarder l'écran et peut se concentrer entièrement sur le test.

2. Les 4 fonctions d'utilisation du Rayonateur peuvent être effectuées également avec le clavier :

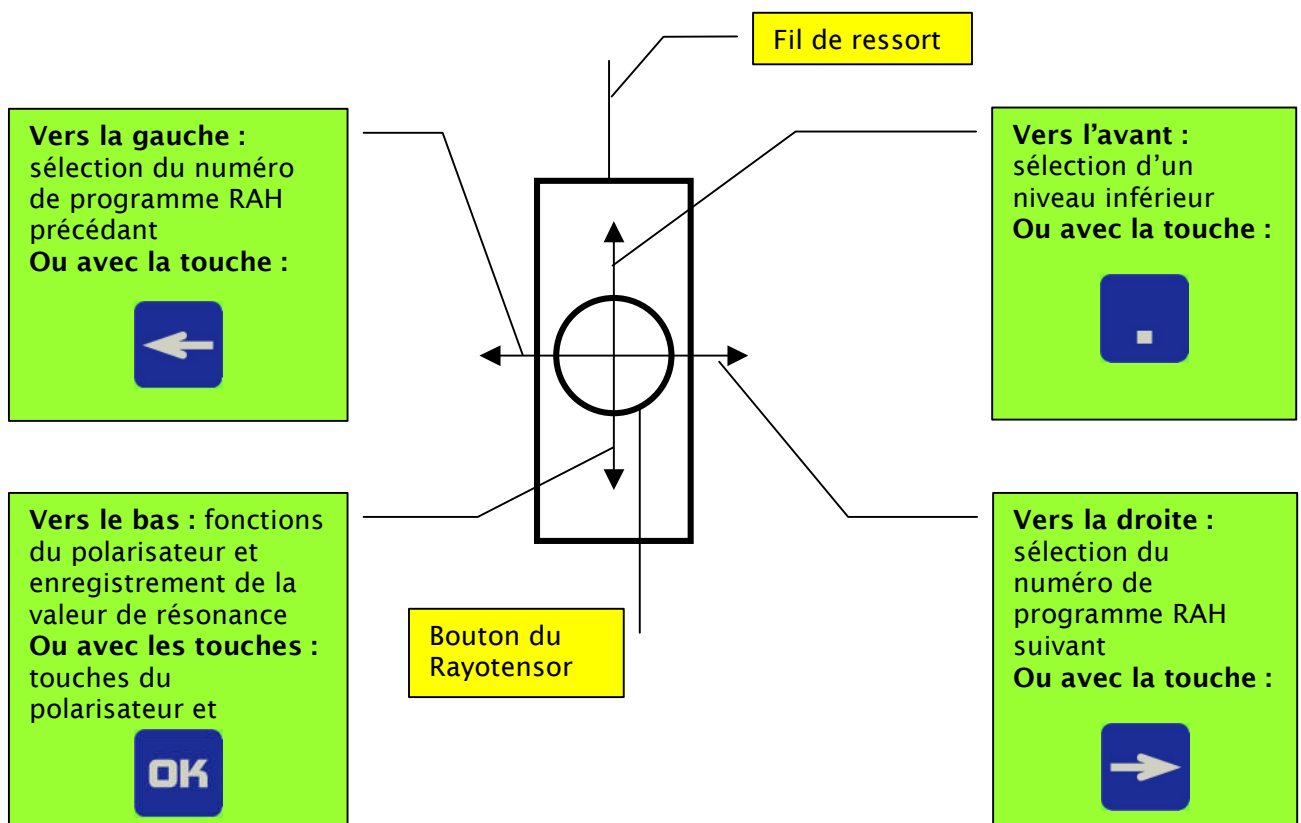


3. La modification directe de la durée d'harmonisation d'une résonance trouvée

A chaque fois qu'une valeur de résonance est enregistrée, il est possible de lui attribuer directement une durée d'harmonisation individuelle.

Pour cela, appuyez sur la touche :



Ensuite, une durée individuelle peut être attribuée au programme RAH (1). A gauche du deux-points vous réglez les heures et à droite du deux-points les minutes. Si vous enregistrez les programmes RAH trouvés sur une « Green-Card » RAH, la durée individuelle de chaque programme sera sauvegardée.

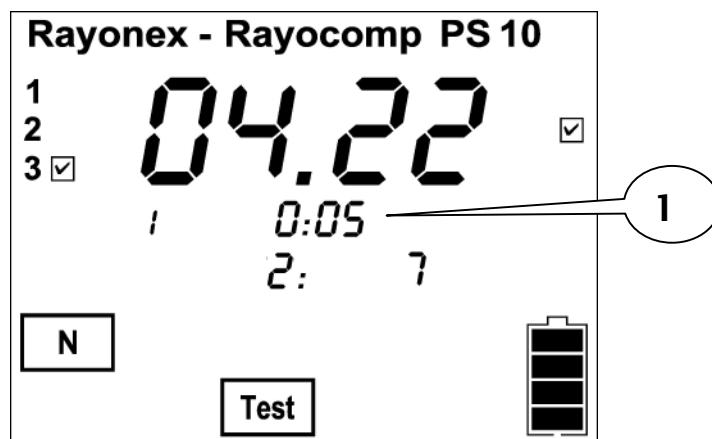

4. Très important : l'effacement de la mémoire de résonance

A chaque fois qu'une nouvelle personne doit être testée, il faut effacer la mémoire de résonance. Après la mise en marche de l'appareil, celle-ci est vide. Elle sera remplie pendant le test avec les programmes RAH et leurs durées d'harmonisation respectives.

Pendant le test RAH, vous pouvez effacer la mémoire de résonance en appuyant sur la touche




L'appareil confirme cette action avec un signal sonore prolongé.

Quand vous insérez une « Green-Card » RAH pour un test, la mémoire de résonance est complètement effacée de façon automatique, afin d'éviter des confusions. Ceci est également valable pour le test avec des protocoles de test.


5. L'enregistrement des programmes RAH trouvés sur une « Green-Card » RAH

Lors d'un test RAH, vous pouvez enregistrer à tout moment les programmes RAH et leurs durées d'harmonisation respectives sur une « Green-Card » RAH. Il est cependant plus utile bien sûr de le faire à la fin du test.

Pour cela, insérez une « Green-Card » RAH et appuyez sur la touche



L'écran affiche ensuite le nombre de programmes RAH (1) et leurs durées d'harmonisation enregistrés.

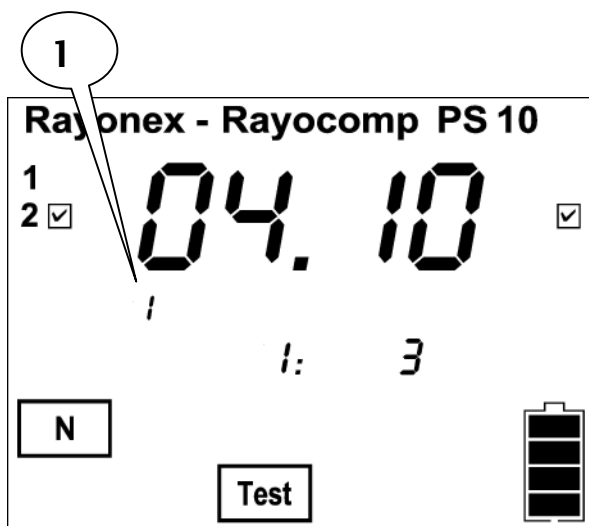

L'enregistrement des numéros de programmes RAH peut également être effectué sous l'option de menu F1. Cette option de menu est le mieux adaptée pour saisir des numéros de programmes RAH individuels et leurs durées d'harmonisation individuelles.

Attention : à chaque fois que vous procédez à l'enregistrement de programmes RAH sur une « Green-Card » RAH, celle-ci sera effacée préalablement avant de sauvegarder les nouveaux programmes RAH. Les programmes RAH enregistrés auparavant sur la carte seront ainsi effacés !


4.5 Option de menu « Configuration »

L'option de menu « Configuration » a été créée afin de pouvoir adapter l'appareil Rayocomp PS 10 individuellement grâce à des préréglages ciblés. Outre les modifications de préréglages, cette option offre des fonctions de test et des fonctions aussi importantes qu'utiles concernant la carte mémoire.

Sélectionnez l'option de menu « Configuration » à l'aide de la touche



Les éléments suivants s'affichent à l'écran:

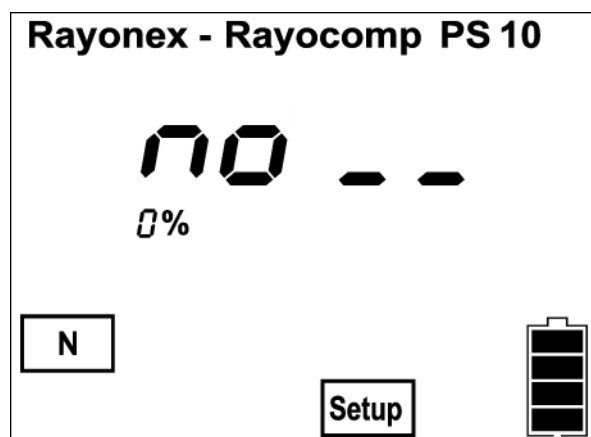

L'appareil attend la saisie d'un numéro de configuration permettant d'accéder de façon ciblée à la fonction de configuration respective. Si vous souhaitez par exemple saisir le numéro de configuration 10, appuyez d'abord sur le 1, ensuite sur le 0, puis sur **OK** pour confirmer votre choix. La suite du mode opératoire est décrite dans les paragraphes suivants.

Pour vous faciliter la procédure, les différents numéros de configuration sont indiqués en grandes lettres rouges dans les paragraphes respectifs.

Attention: Vous ne pouvez provoquer aucun dommage ni supprimer durablement des éléments dans l'appareil par les réglages dans la configuration. Chaque réglage effectué sur l'appareil peut être réinitialisé à son état d'origine. Osez et faites des essais. C'est ainsi que vous apprendrez le mieux à connaître votre appareil Rayocomp PS 10.

4.5.1 Configuration du rétroéclairage

Numéro de configuration: 10

L'écran de l'appareil Rayocomp PS 10 a été équipé d'un rétroéclairage pour en faciliter la lecture. Les indications figurant sur l'écran pourront ainsi toujours être relevées avec précision, notamment en cas d'éclairage médiocre. Le rétroéclairage dispose de trois modes de fonctionnement. Après avoir saisi le numéro de configuration 10, vous pouvez indiquer les valeurs suivantes:

- 0: Le rétroéclairage est toujours éteint.
- 1: Le rétroéclairage est toujours allumé.
- 2: Le rétroéclairage est réglé sur Mode automatique. 30 secondes après le dernier actionnement d'une touche, le rétroéclairage s'éteint. Lorsque vous appuyez à nouveau sur une touche, le rétroéclairage s'allume à nouveau. Ceci économise la batterie et augmente les durées de service. D'autre part le rétroéclairage n'est pas gênant en cas d'utilisation nocturne, puisqu'il serait néanmoins suffisamment puissant pour empêcher éventuellement une personne de dormir.

Le réglage standard lors de la livraison de l'appareil Rayocomp PS 10 est le 2.

4.5.2 Suppression de valeurs et de programmes doubles

Numéro de configuration: 11

Lorsque différents programmes F1 sont combinés, il est évidemment possible que certaines valeurs fondamentales de fréquences se répètent. Si vous souhaitez que les doublons des valeurs fondamentales de fréquences ne soient pas harmonisés, cette fonction en permet le réglage.

Ceci est également valable pour les combinaisons de programmes RAH. Les doublons de programmes sont ignorés lors de l'harmonisation. Lors du test avec les programmes RAH, les doublons de saisie (p.ex. depuis une carte mémoire) sont éliminés ; chaque programme RAH n'est sélectionné qu'une seule fois.

Après avoir saisi le numéro de configuration 11, vous pouvez indiquer les valeurs suivantes :

- 0: Ne pas supprimer les doublons lors du chargement des programmes F1 et des programmes RAH!
- 1: Supprimer les doublons lors du chargement des programmes F1 et des programmes RAH!

Le réglage standard lors de la livraison de l'appareil Rayocomp PS 10 est le 0.

4.5.3 Réglage de l'avertissement sonore (bip)

Numéro de configuration: 12

L'appareil Rayocomp PS 10 est équipé d'un générateur de signaux acoustiques. Celui-ci indique par ex. l'actionnement d'une touche erronée ou la confirmation d'une saisie.

L'appareil Rayocomp PS 10 différencie trois types d'erreurs et dispose d'autant de signaux sonores:

1. **Un son prolongé:** l'appareil confirme ainsi une action achevée avec succès, par ex. une saisie ou un enregistrement.
2. **Deux sons courts:** la touche actionnée ne dispose à cet endroit d'aucune fonction spécifique.
3. **Deux sons prolongés:** une erreur critique est survenue. L'appareil édite un code d'erreur. Vous trouverez en annexe (chapitre 5.8) la liste des messages et des défaillances correspondantes.

Cette fonction de configuration vous permet d'activer ou de désactiver le signal. Après avoir saisi le numéro de configuration 12, vous pouvez indiquer les valeurs suivantes:

- 1: Le signal sonore est activé.
- 0: Le signal sonore est désactivé.

Le réglage standard lors de la livraison de l'appareil Rayocomp PS 10 est le 1.

4.5.4 Définition des valeurs de plage de test

Numéro de configuration: 13

Un des procédés de biorésonance d'après Paul Schmidt ayant rencontré le plus de succès est le test de valeurs dans une plage. Dans ce contexte toutes les valeurs fondamentales de fréquences sont testées quant à leur résonance et harmonisées ensuite, à commencer par une valeur de départ, normalement 00.00, jusqu'à une valeur finale, normalement 99.99, avec un intervalle de par ex. 00.50 entre deux mesures respectives. Ces trois valeurs peuvent être définies dans la présente fonction de configuration. Après avoir saisi le numéro de configuration 13, indiquez d'abord la valeur de départ. Après avoir confirmé à l'aide de la touche **OK**, saisissez la valeur finale.

Lorsque vous aurez confirmé celle-ci également en appuyant sur la touche **OK**, définissez l'intervalle, par ex. à une valeur plus précise telle que 0.25. L'intervalle devra également – comme toujours d'ailleurs – être confirmé à l'aide de la touche **OK**.

Les valeurs standard configurées dans l'appareil Rayocomp PS 10 lors de la livraison sont:

Valeur de départ: 00.00


Valeur finale: 99.99

Intervalle: 00.50

4.5.5 Définition de la durée d'harmonisation des valeurs fondamentales de fréquences

Numéro de configuration: 14

La définition de la durée d'harmonisation des valeurs fondamentales de fréquences peut s'avérer utile tant pour l'application d'un programme BnPS que pour l'utilisation d'une « Green-Card » RAH. Lors de l'enregistrement de fréquences individuelles ainsi que de programmes RAH sur une « Green-Card » RAH, les durées d'harmonisation individuelles peuvent être enregistrées pour les programmes RAH, mais pas pour les fréquences individuelles. Quand vous démarrez ensuite le processus automatique d'harmonisation grâce à la « Green-Card » RAH, vous pouvez régler la durée d'harmonisation des fréquences individuelles au moyen du pré-réglage de la durée d'harmonisation. Le réglage standard est de 30 secondes. Par contre, si vous modifiez sous l'option de menu « Configuration » la durée d'harmonisation à 1 minute, lors du processus automatique déclenché par la « Green-Card » RAH, chaque valeur fondamentale de fréquence dans l'appareil Rayocomp PS 10 sera harmonisée pendant 1 minute.

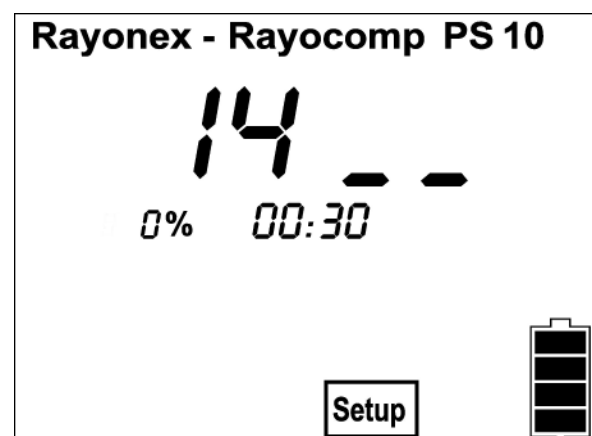

Ceci est également le cas lors de l'utilisation des programmes BnPS. La durée d'harmonisation pré-réglée est directement proposée.

Après avoir saisi le numéro de configuration 14, confirmez à l'aide de la touche **OK**. Les éléments suivants s'affichent à l'écran :

L'indication 00.30 signifie 00 minutes et 30 secondes. D'abord, le champ de saisie des minutes clignote. Saisissez p.ex. 0100 et confirmez ensuite à l'aide de la touche **OK**. Le préréglage est à présent une minute.

La saisie de 0040 signifierait le préréglage de 40 secondes.

4.5.6 Activation et désactivation de modules

Numéro de configuration: 20

Actuellement, neuf modules peuvent être activés ou désactivés dans l'appareil Rayocomp PS 10. Si par exemple les programmes d'harmonisation de la thérapie d'acupuncture par fréquences sont désactivés, ils pourront être utilisés immédiatement après leur activation à l'aide d'un code d'activation. Cette option de menu secondaire est destinée à l'activation et la désactivation des modules.

Après avoir saisi le numéro de configuration 20, vous pouvez sélectionner le numéro du module que vous souhaitez activer ou désactiver (confirmez chaque saisie à l'aide de la touche **OK**).

Voici les numéros correspondant aux différents modules:

N° module	Désignation
01	Précision de réglage de 0.05
02	54 programmes d'harmonisation intégrés
03	14 Thérapie d'acupuncture par fréquences
04	22 programmes selon Dr. Ulrich
05	9 programmes spéciaux
06	11 programmes de test
08	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 8
09	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 9
10	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 10

Saisissez ensuite le code à 7 caractères réservé à l'activation et la désactivation, et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.


4.5.7 Enregistrement des valeurs fondamentales de fréquences sur la carte mémoire

Numéro de configuration: 30


Un des avantages particuliers de l'appareil Rayocomp PS 10 est l'utilisation de cartes mémoire. Ces cartes permettent d'enregistrer des combinaisons de fréquences, qui seront ensuite testées sous l'option de menu « Test-BnPS » ou harmonisées sous l'option de menu « F1-BnPS ». Cette fonction de configuration vous permet de créer votre propre carte mémoire. La combinaison de fréquences peut être enregistrée soit sur une carte mémoire normale soit sur une « Green-Card » RAH.

Insérez à cet effet la carte mémoire dans l'appareil et saisissez ensuite le numéro de configuration 30. Chaque valeur fondamentale de fréquence confirmée en appuyant sur la touche **OK** sera alors enregistrée sur la carte mémoire.

Les éléments suivants s'affichent à l'écran:

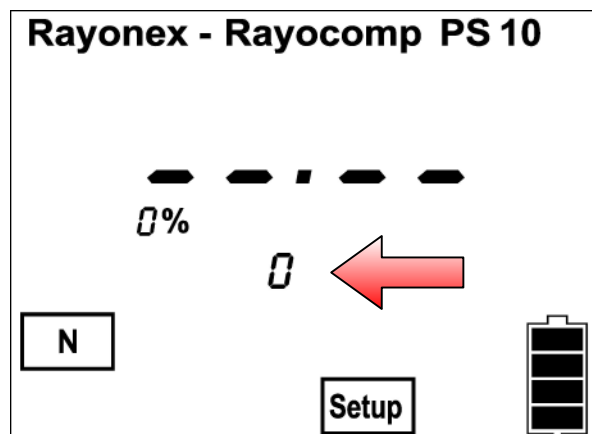

L'élément indiqué par la flèche rouge indique le nombre des valeurs actuellement enregistrées sur la carte.

La touche  permet de supprimer la dernière valeur saisie.

Si la carte devait encore contenir des valeurs que vous souhaitez supprimer, utilisez le numéro de configuration 43, reportez-vous également au chapitre 4.5.10, Supprimer toutes les données de la carte mémoire.


4.5.8 Afficher des informations relatives à la carte mémoire

Numéro de configuration: 40

Si vous deviez vous trouver en possession d'une carte mémoire dont vous ne savez pas combien de valeurs y sont enregistrées, de quelle carte il s'agit, etc., cette fonction de configuration pourra vous être utile.

Puisque une « Green-Card » RAH peut contenir tant des valeurs fondamentales de fréquences que des programmes RAH, l'appareil indique alternativement les valeurs BnPS et les valeurs RAH. Une « Green-Card » RAH peut enregistrer jusqu'à 500 valeurs BnPS et 200 programmes RAH. Vous pouvez trouver le nombre de programmes RAH enregistrés à côté du chiffre 200 quand il s'affiche à l'écran (p. ex. 34:200).

Insérez à cet effet la carte mémoire dans l'appareil et saisissez ensuite le numéro de configuration 40. Les éléments suivants s'affichent alors à l'écran (exemple) :

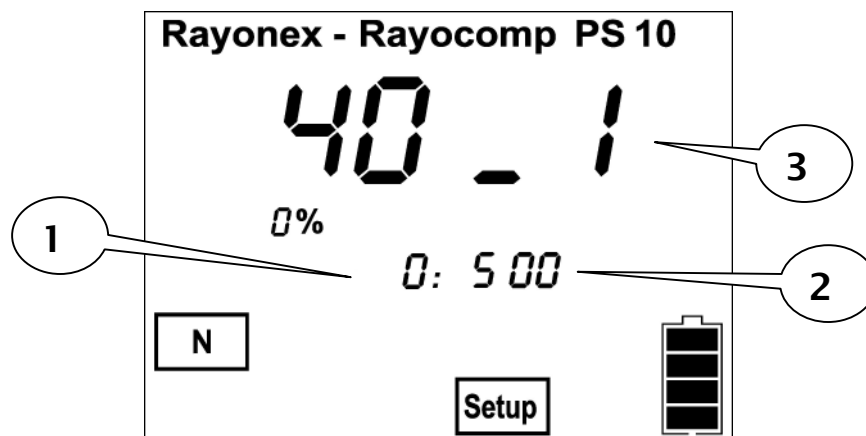

Légende:

- 1: Indique le nombre de valeurs actuellement enregistrées sur la carte.
- 2: Indique le nombre de valeurs pouvant être enregistrées sur la carte. A l'exception de la « Green-Card » RAH qui contient 500 valeurs BnPS et 200 valeurs RAH qui sont affichés alternativement.
- 3: Si un 0 s'affiche, la carte est défectueuse. Si un 1 s'affiche, il s'agit d'une destinée à l'utilisation dans le cadre de la biorésonance d'après Paul Schmidt. Une Green-Card » RAH est marquée avec un 3.

4.5.9 Mise en place d'une protection de lecture pour la carte mémoire

Numéro de configuration: 41

Cette fonction de configuration vous permet de mettre en place une protection de lecture pour la carte mémoire. Si une carte protégée en lecture est insérée dans un appareil Rayocomp, par ex. sous « F1-BnPS », les valeurs fondamentales de fréquences sont réglées, mais non affichées. Ceci peut s'avérer utile lors du développement et du test de nouvelles valeurs fondamentales de fréquences. Insérez la carte mémoire à protéger en lecture dans l'appareil Rayocomp PS 10. Lorsque vous aurez saisi le numéro de configuration 41, l'écran affiche soit un 0 (carte non protégée en lecture) ou un 1, si la carte dispose déjà d'une protection de lecture. Une « Green-Card » RAH ne peut pas être protégée en lecture.

Si la carte n'est pas encore protégée en lecture, saisissez un 1 et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

N'oubliez pas que la protection de lecture d'une carte mémoire ne peut être annulée qu'en supprimant l'ensemble du contenu de la carte ; reportez-vous à ce sujet au chapitre 4.5.10.

4.5.10 Mise en place d'une protection d'écriture pour la carte mémoire

Numéro de configuration: 42

Cette fonction de configuration vous permet de mettre en place ou d'annuler une protection d'écriture pour la carte mémoire. Cette fonction empêche la suppression non intentionnelle du contenu de la carte mémoire ainsi que l'enregistrement de valeurs supplémentaires.

Insérez la carte mémoire à protéger en écriture dans l'appareil Rayocomp PS 10. Lorsque vous aurez saisi le numéro de configuration 42, l'écran affiche soit un 0 (carte non protégée en écriture) ou un 1, si la carte dispose déjà d'une protection d'écriture.

Si la carte n'est pas encore protégée en écriture, saisissez un 1 et confirmez en appuyant sur la touche **OK**, afin de pourvoir cette carte mémoire d'une protection d'écriture.

Si un 1 s'affiche à l'écran, et que la carte est donc protégée en écriture, vous pouvez annuler cette protection en saisissant un 0 et en confirmant à l'aide de la touche **OK**.

4.5.11 Suppression du contenu complet de la carte mémoire

Numéro de configuration: 43

Cette fonction de configuration permet de supprimer l'ensemble du contenu d'une carte mémoire et de la préparer ainsi pour de nouveaux processus d'écriture.

Si vous supprimez le contenu d'une carte à l'aide de cette fonction, la suppression ne concerne pas seulement les valeurs fondamentales de fréquences qu'elle contient, mais également toute protection de lecture ou d'écriture éventuellement en place.

Insérez la carte mémoire dont le contenu doit être supprimé intégralement dans l'appareil Rayocomp PS 10. Après avoir saisi le numéro de configuration 43, un 0 s'affiche à l'écran. Vous devez maintenant saisir pour des raisons de sécurité un 1 et confirmer en appuyant sur la touche **OK**.

4.5.12 Initialisation de la carte mémoire

Numéro de configuration: 44

Si vous deviez vous trouver un jour en possession d'une carte mémoire dont l'étiquette n'est plus lisible, vous pouvez tester cette carte à l'aide de la fonction de configuration et la réinitialiser. Cette fonction s'applique tant aux cartes mémoire de biorésonance d'après Paul Schmidt qu'aux « Green-Card » RAH.

Si vous initialisez la carte mémoire à l'aide de cette fonction, les valeurs système de la carte sont déterminées et écrites à nouveau, et les valeurs fondamentales de fréquences qu'elle contenait seront supprimées. Toute protection de lecture ou d'écriture éventuelle sera également supprimée.


Insérez la carte mémoire à initialiser dans l'appareil Rayocomp PS 10. Après avoir saisi le numéro de configuration 44, un 0 s'affiche à l'écran. Vous devez maintenant saisir pour des raisons de sécurité un 1 et confirmer en appuyant sur la touche **OK**.

4.5.13 Marche d'essai du moteur du module de fréquence

Numéro de configuration: 50

Cette fonction de configuration permet à l'utilisateur de contrôler le module de fréquence à entraînement mécanique de l'appareil Rayocomp PS 10. Lorsque l'appareil Rayocomp a été soumis par ex. durant un transport prolongé à des vibrations, cette fonction permet de vérifier le bon fonctionnement du module de fréquence.

Après avoir saisi le numéro de configuration 50 et confirmé la saisie en appuyant sur la touche **OK**, l'appareil Rayocomp PS 10 lance une marche d'essai. Le progrès de la marche d'essai s'affiche à l'écran. En fin d'essai, l'appareil doit afficher le message suivant à l'écran:

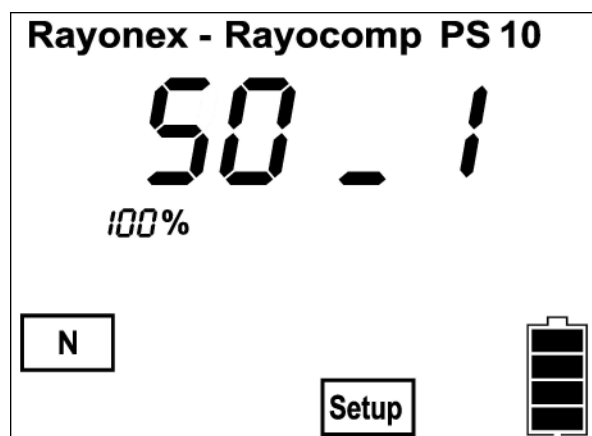


Le 1 après le 50 indique que le module de fréquence fonctionne de façon optimale. Si un 0 s'affiche à cet endroit, l'essai a révélé une défaillance. Dans ce cas, répétez la marche d'essai. Si le résultat affiché est toujours 0, l'appareil Rayocomp PS 10 doit nous être retourné pour réparation.

4.6 Option de menu « Info »

Le menu « Info » vous permet d'afficher rapidement l'ensemble des informations importantes concernant l'appareil.

Vous accédez à l'option de menu « Info » en appuyant de façon répétée sur la

touche **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche les éléments suivants:

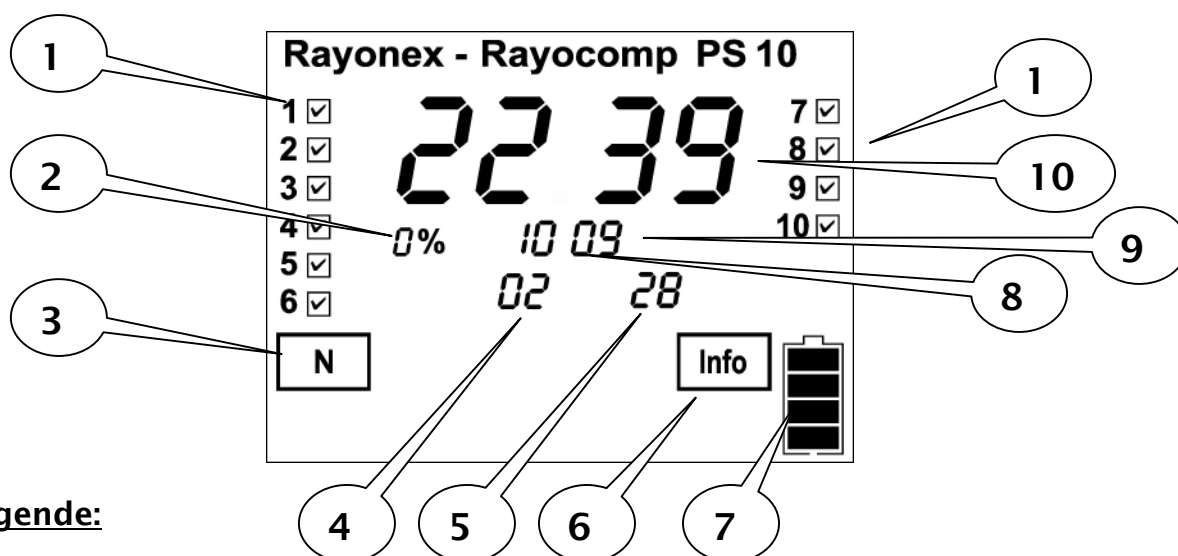

Légende:

1: L'appareil Rayocomp PS 10 dispose actuellement de dix modules. Les cases 1 à 10 indiquent, si elles sont cochées, que les modules respectifs sont intégrés dans l'appareil. Voici une liste des différents modules :

N° module	Réf. art.	Désignation
1	2010	Précision de réglage de 0.05
2	2020	54 programmes d'harmonisation intégrés
3	2030	14 Thérapie d'acupuncture par fréquences
4	2040	22 programmes selon Dr. Ulrich
5	2050	9 programmes spéciaux
6	2070	11 programmes de test
8	2080	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 8
9	2090	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 9
10	2092	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 10

Concernant le module 1, il est important de savoir que l'appareil dispose de façon standard d'une précision de 0.25, donc par ex. 12.50, 12.75, etc. Si le module 1 a été réglées, les valeurs fondamentales de fréquences peuvent être réglées avec la précision supérieure de 0.05, donc par ex. 12.50, 12.55, etc.

2. Cette zone indique l'état de maintenance actuel de l'appareil. Après environ 6.000 heures de service, l'appareil affichera 100 % (maintenance nécessaire). Il doit alors nous être envoyé pour révision.
3. Cette zone affiche le mode de polarisation configuré actuellement. Il ne s'agit pas d'une information spéciale, puisqu'elle s'affiche également dans les autres options de menu. Pour des raisons d'intégralité, elle figure aussi ici.
4. Le chiffre figurant ici indique la version matérielle de l'appareil. Dans le cas présent, il s'agit de la version 2. 2. Les appareils affichant la version 2 sont déjà préparés de façon à pouvoir activer le module RAH grâce à un code d'activation. Les appareils affichant la version 2 doivent être transformés d'abord. A cet effet, veuillez contacter la société Rayonex.
5. Le chiffre figurant ici indique la version du logiciel de l'appareil. Dans le cas présent, il s'agit de la version 10.
6. Ici figure l'information concernant l'option de menu que vous avez sélectionnée actuellement.
7. Cette zone indique le niveau de chargement de la batterie.
8. Le chiffre figurant ici indique le mois de construction de l'appareil, dans le cas présent le mois d'octobre.
9. Cette zone indique l'année de construction de l'appareil. Dans notre exemple il s'agit de l'année 2009.
10. Ces quatre chiffres constituent le numéro de série de l'appareil. Ce chiffre, par exemple le 22.39, est important lorsqu'il s'agit de la classification univoque de l'appareil. La société Rayonex dispose d'une banque de données dans laquelle figurent toutes les informations relatives à l'appareil, par ex. les modules intégrés, la date de la dernière maintenance, etc.

Si vous considérez par ex. de faire activer un module dans l'appareil Rayocomp PS 10, l'indication du numéro de série nous permet de vous communiquer (par ex. par téléphone) un code d'activation autorisant l'utilisation immédiate du module.


Un conseil très important à ce sujet:

Si vous souhaitez essayer des modules individuels, nous pouvons vous communiquer un code d'activation temporaire. Ce code à usage unique vous permettra d'essayer le module respectif pendant une durée d'environ 10 heures. Le module RAH peut même être testé pendant 100 heures. Ce qui est déterminant dans ce cas, c'est la durée d'utilisation de l'appareil et non pas la durée d'utilisation du module. Durant ce délai, vous pourrez obtenir suffisamment d'informations pour évaluer l'importance du module.

4.7 Touches de fonctions spéciales

L'appareil Rayocomp PS 10 dispose en tout de quatre touches spéciales affectées à des fonctions particulières.

Important: Chacune de ces quatre touches n'est accessible que sous l'option de menu « Direct ».

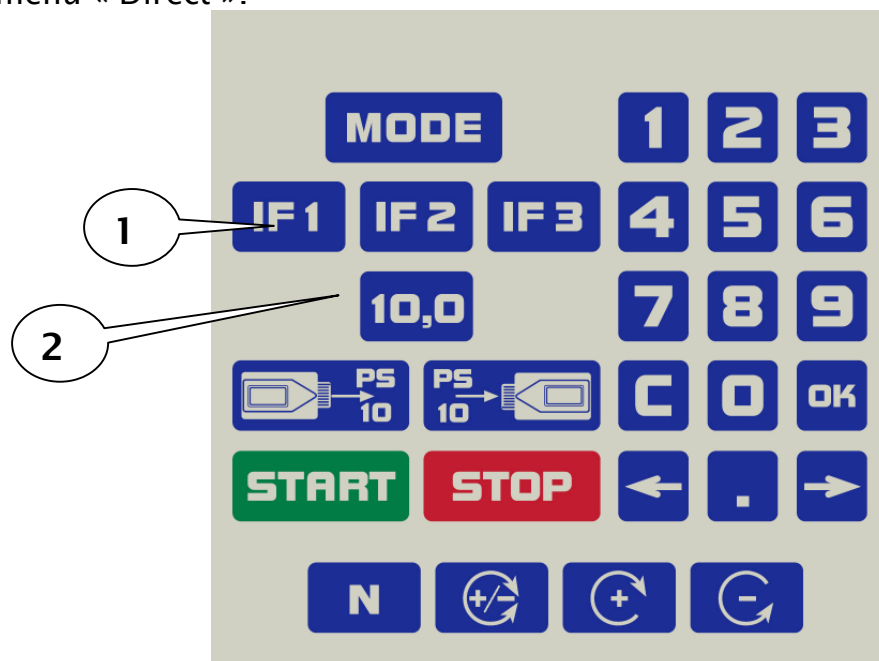

Légende:

- 1: Trois touches IF : IF 1, IF 2 et IF 3
2. La touche 10.0

4.7.1 Utilisation des touches *IF*

Les touches *IF* (Individuelle Frequenzgrundwerte - valeurs fondamentales de fréquences individuelles) permettent de mémoriser des valeurs fondamentales de fréquences utilisées fréquemment. Leur mode de fonctionnement est similaire aux touches de préréglage des stations radio. On règle d'abord la station, ensuite on appuie de façon prolongée sur la touche, et la station est mémorisée. Les trois touches *IF* fonctionnent selon le même principe. Choisissez sous le point de menu « Direct » la valeur fondamentale de fréquence. Confirmez le choix avec OK. Appuyez ensuite sur le bouton *IF* choisi jusqu'à vous entendez un signal sonore. La valeur a été mémorisée sous cette touche et peut être appelée rapidement en appuyant sur la touche *IF*. Il est possible de mémoriser ainsi jusqu'à trois valeurs fondamentales de fréquences (*IF 1*, *IF 2* et *IF 3*).

4.7.2 Utilisation de la touche *10.0*

La touche *10.0* a été affectée définitivement à cette valeur fondamentale de fréquence. Cette valeur fondamentale de fréquence fréquemment utilisée (harmonisation des allergènes, énergie, duplication, ...) est ainsi accessible rapidement et à tout moment. Cette touche a également une fonction spéciale dans le module M10.

5. Annexe

5.1 Aperçu des programmes de test intégrés

Affichage	Nom du programme
P 01	Test de valeurs dans une plage
P 02	Test avec des valeurs de carte mémoire
P 03	Test avec des programmes intégrés
P 04	Test d'électrosmog
P 05	Test de géopathie
P 06	Test de check-up
P 07	Test de bactéries et de virus
P 08	Test de parasites
P 09	Test d'acides et de bases
P 10	Test rapide des 14 méridiens
P 11	Test de substances vitales

5.2 Aperçu des programmes Rayonex intégrés

Affichage	Nom du programme
P 1.01	Cervelet
P 1.02	Nerfs
P 1.03	Artères
P 1.04	Veines
P 1.05	Éléments cellulaires
P 1.06	Cheveux
P 1.07	Peau
P 1.08	Organes d'audition et d'équilibre
P 1.09	Langue
P 1.10	Organe olfactif
P 1.11	Organe oculaire
P 1.12	Cerveau
P 1.13	Noyaux et voies du cerveau
P 1.14	Système lymphatique
P 1.15	Rate
P 1.16	Pancréas
P 1.17	Foie
P 1.18	Œsophage
P 1.19	Poumons
P 1.20	Glandes hormonales
P 1.21	Moelle épinière
P 1.22	Larynx
P 1.23	Diaphragme
P 1.24	Plèvre
P 1.25	Péritoine
P 1.26	Organes sexuels masculins
P 1.27	Organes sexuels féminins
P 1.28	Uretère
P 1.29	Estomac
P 1.30	Duodénum
P 1.31	Intestin grêle
P 1.32	Gros intestin
P 1.33	Vésicule biliaire
P 1.34	Reins
P 1.35	Cœur
P 1.36	Colonne vertébrale
P 1.37	Squelette - extrémités inférieures
P 1.38	Pieds
P 1.39	Cage thoracique
P 1.40	Epaule
P 1.41	Crâne
P 1.42	Squelette - extrémités supérieures
P 1.43	Mains
P 1.44	Muscles - extrémités inférieures
P 1.45	Muscles - extrémités supérieures
P 1.46	Thorax
P 1.47	Cou
P 1.48	Tête
P 1.49	Mains
P 1.50	Ganglions
P 1.51	Prérégulation
P 1.52	Système immunitaire
P 1.53	Dépressions
P 1.54	Dents

5.3 Aperçu des programmes d'acupuncture intégrés

Affichage	Nom du programme
P 2.01	Méridien du Poumon
P 2.02	Méridien du Gros Intestin
P 2.03	Méridien de l'Estomac
P 2.04	Méridien de la Rate - Pancréas
P 2.05	Méridien du Cœur
P 2.06	Méridien de l'Intestin Grêle
P 2.07	Méridien de la Vessie
P 2.08	Méridien du Rein
P 2.09	Méridien du Foie
P 2.10	Méridien du Maître du Cœur
P 2.11	Méridien du Triple Réchauffeur
P 2.12	Méridien de la Vésicule Biliaire
P 2.13	Méridien du Vaisseau Gouverneur
P 2.14	Méridien du Vaisseau Conception

5.4 Aperçu des programmes spéciaux intégrés

Affichage	Nom du programme
P 3.01	Check-up
P 3.02	Cicatrisation
P 3.03	Bactéries / virus
P 3.04	Parasites
P 3.05	Réseau global
P 3.06	Veines d'eau
P 3.07	Failles
P 3.08	Géopathie - globale
P 3.09	Chakras

5.5 Aperçu des programmes Dr. Ulrich intégrés

Affichage	Nom du programme
P 4.01	Programme allergie
P 4.02	Programme stress
P 4.03	Programme de protection contre l'ozone
P 4.04	Programme d'apprentissage
P 4.05	Programme mycoses
P 4.06	
P 4.07	Programme acidose
P 4.08	Programme hormones féminines
P 4.09	Programme hormones masculines
P 4.10	Programme post-traitement
P 4.11	
P 4.12	Programme acouphène
P 4.13	Programme constantes en physique
P 4.14	Programme nettoyage
P 4.15	Programme spirituel 1, stress avec partenaire
P 4.16	Programme spirituel 2, Kundalini
P 4.17	Programme spirituel 3, protection
P 4.18	Programme cœur
P 4.19	Programme diabète
P 4.20	Programme asthme
P 4.21	Programme pesticides
P 4.22	Programme panique
P 4.23	Programme intolérance au fructose
P 4.24	Programme protection contre radioactivité

5.6 Aperçu des modules intégrables

N° module	Réf. art.	Désignation
01	2010	Précision de réglage de 0,05
02	2020	54 programmes d'harmonisation intégrés
03	2030	14 Thérapie d'acuponcture par fréquences
04	2040	24 programmes selon Dr. Ulrich
05	2050	9 programmes spéciaux
06	2070	11 programmes de test
08	2080	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 8
09	2090	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 9
10	2092	Système d'analyse et d'harmonisation Rayonex (RAH) Module 10
11	---	Non affecté
12	---	Non affecté

5.7 Aperçu des messages d'erreur disponibles

N°	Description
11	Type de carte erroné
12	Absence de carte valide
13	Absence de carte
14	La durée d'harmonisation doit être d'au moins 1 seconde
15	Ce mode de configuration n'existe pas
16	Code d'activation de module erroné
17	Initialisation erronée de la carte
18	La valeur finale doit être supérieure à la valeur de départ
19	Bouton d'arrêt défectueux Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
20	Contact du moteur défectueux Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
21	La position neutre ne pouvait pas être réglé correctement. Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
22	La carte est protégée en écriture
23	Le module n'est pas activé
24	Le nombre de valeurs de résonance sélectionnées est supérieur à l'espace disponible sur la carte
25	Cette carte ne peut être protégée en lecture et en écriture
26	La capacité maximale de mémoire est atteinte
27	Ce module a déjà été activé temporairement
28	Absence de « Green-Card » RAH
29	Tension très faible ! Rechargez la batterie !
30	Votre appareil nécessite une révision
31	Ce groupe de programmes n'existe pas
32	Terminez d'abord le programme actuel en appuyant 2 x sur la touche STOP
33	Le programme de test n'existe pas
34	Carte défectueuse
35	La carte ne peut pas être initialisée
36	Les valeurs à mémoriser contiennent des valeurs protégées en lecture qui ne peuvent pas être enregistrées
37	La carte a été retirée durant l'enregistrement
38	Le polarisateur n'a pas été réglé sur le mode choisi. Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
39	Une erreur matérielle du module RAH est survenue.
40	Veillez retirer la carte de l'appareil.
41	Ce programme RAH peut seulement être sélectionné dans les modules 9 et 10
42	La sélection contient plus de 200 programmes RAH
43	Valeur double
44	Un problème est survenu lors de l'enregistrement d'une valeur
45	La lecture de la « Green-Card » RAH ne fonctionne qu'à partir du module 9
46	Limitation à 200 programmes RAH
47	Ce programme n'est pas inclus. Une mise à jour est recommandée.

N°	Description
54	Ce n° de programme n'existe pas (reportez-vous à la liste des programmes)
55	Code erroné
56	Le module 10 n'est pas activé
65	Seuls les modules 1 - 10 existent
85	Ce programme RAH n'existe pas
86	Un maximum de 200 programmes RAH peut être chargé à la suite
87	Aucune valeur n'est disponible sur la carte mémoire
88	Aucune carte mémoire « valide » n'est insérée. Veuillez vérifier la carte ou la réinitialisée le cas échéant (voir l'option de menu « Configuration » 40 et 44)
89	Vous avez sélectionné plus de 500 valeurs sous F1
90	Ce programme F1 n'existe pas (reportez-vous à la liste des programmes)
92	Ce module ne peut pas être activé avec la version de matériel actuelle. Si le module RAH vous intéresse, vous pouvez contacter la société Rayonex.
99	Erreur de programme



Rayonex Schwingungstechnik GmbH

Sauerland-Pyramiden 1 • 57368 Lennestadt
Tel.: +49 2721 6006-0 • Fax: +49 2721 6006-66
Internet: www.rayonex.de • E-mail: info@rayonex.de

FB-146 • Rev28 • Stand: 01. Februar 2013